

综合统计平台医用设备调查表

(代报)

(区县端)

用户操作手册

北京万兴新锐科技发展有限公司

2010年5月

目 录

第一章 系统简介.....	1
1.1 系统常用图标.....	1
第二章. 系统登录.....	2
2.1 系统登录.....	2
第三章. 数据填报与查找.....	3
3.1 数据填报.....	3
3.2 数据查找.....	10
第四章. 数据导出功能.....	16
4.1 数据在多行模式下导出.....	16
4.2 数据在单行模式下导出.....	18
第五章. 其它注意事项.....	22

第一章 系统简介

1.1 系统常用图标

 <p>新建</p>	新建一条数据
 <p>保存</p>	保存当前信息
 <p>删除</p>	删除指定数据
 <p>刷新</p>	刷新页面
 <p>恢复</p>	恢复到上一步操作
 <p>查找</p>	查找数据
 <p>导入</p>	导入模板
 <p>导出</p>	以 excel 形式导出保存
 <p>上翻</p>	上一条数据
 <p>下翻</p>	下一条数据
 <p>切换</p>	切换到明细页面
 <p>附件</p>	下载附件

第二章. 系统登录

2.1 系统登录

1. 在 IE 地址栏输入地址：<http://210.75.201.217/bjhbstat/>，点击“转入”按钮。如图 2-1 所示：

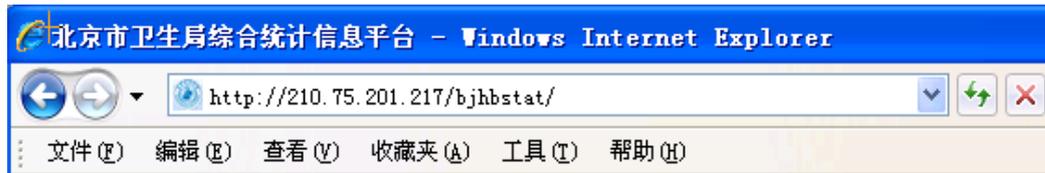


图 2-1 转换界面

2. 进入系统登录界面，如图 2-2 所示：



图 2-2 登录界面

3. 成功登录, 如图 2-3 所示:



图 2-3 系统登录

第三章. 数据填报与查找

3.1 数据填报

1. 进入综合信息统计平台，在系统菜单中点击“代报自审”，如图 3-1 所示：



图 3-1 数据填报

2. 选择“医用设备调查表(代报)”，如图 3-2 所示：

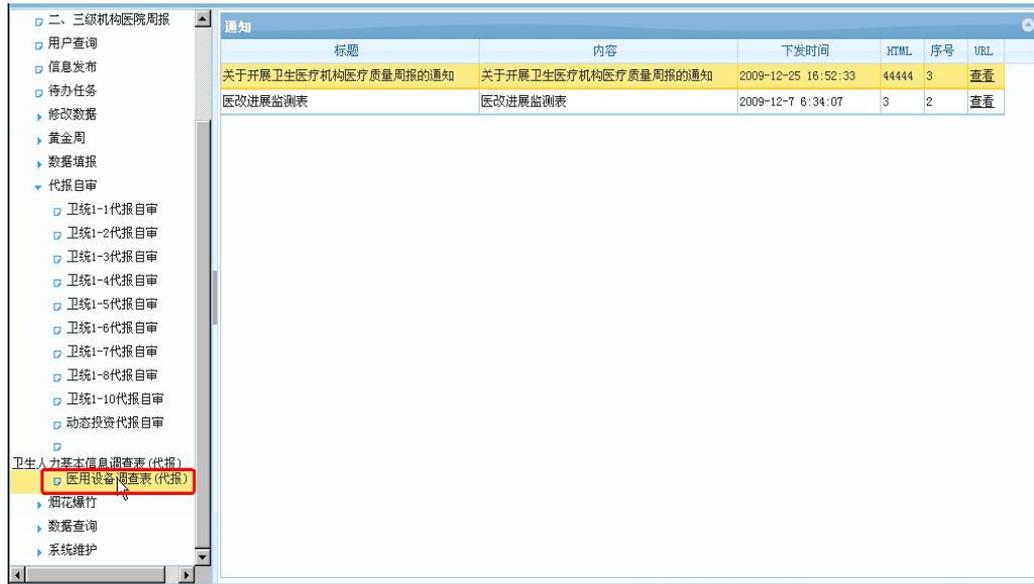


图 3-2 数据填报

3. 进入医用设备调查表模块，切换到“机构列表”页签，如图 3-3 所示：

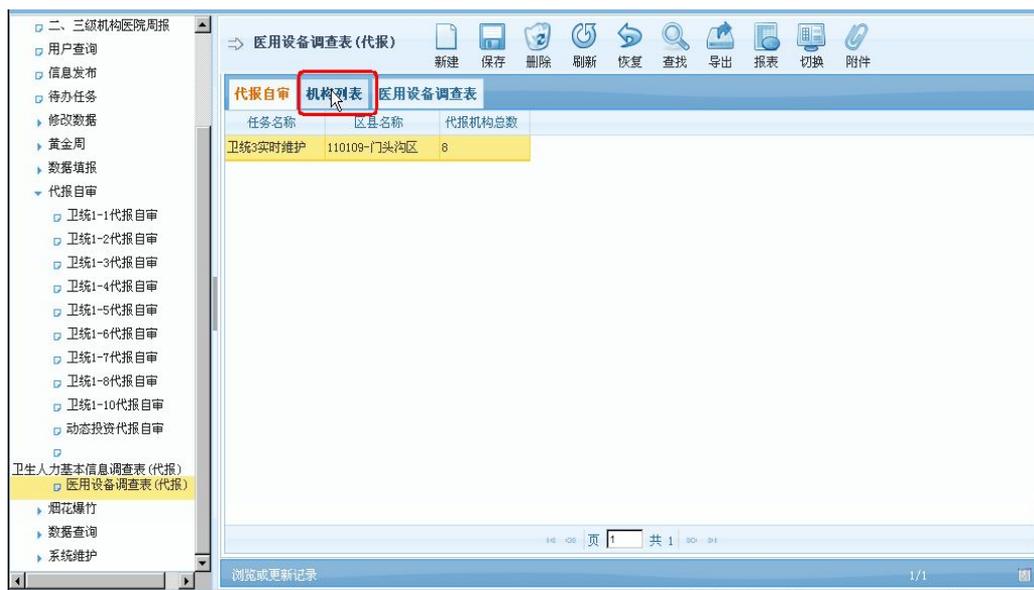


图 3-3 数据填报

4. 选中一家医疗机构，如图 3-4 所示：

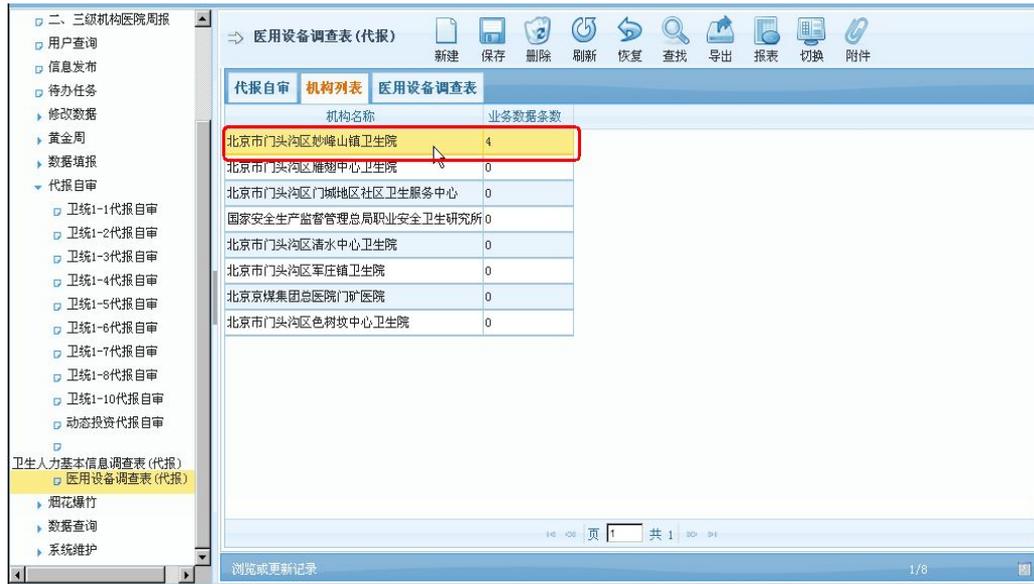


图 3-4 数据填报

5. 切换到“医用设备调查表”页签，如图 3-5 所示：



图 3-5 数据填报

6. 页面中显示该医疗机构的医用设备调查表明细，用户可进行数据添加、修改的操作。如图 3-6 所示：

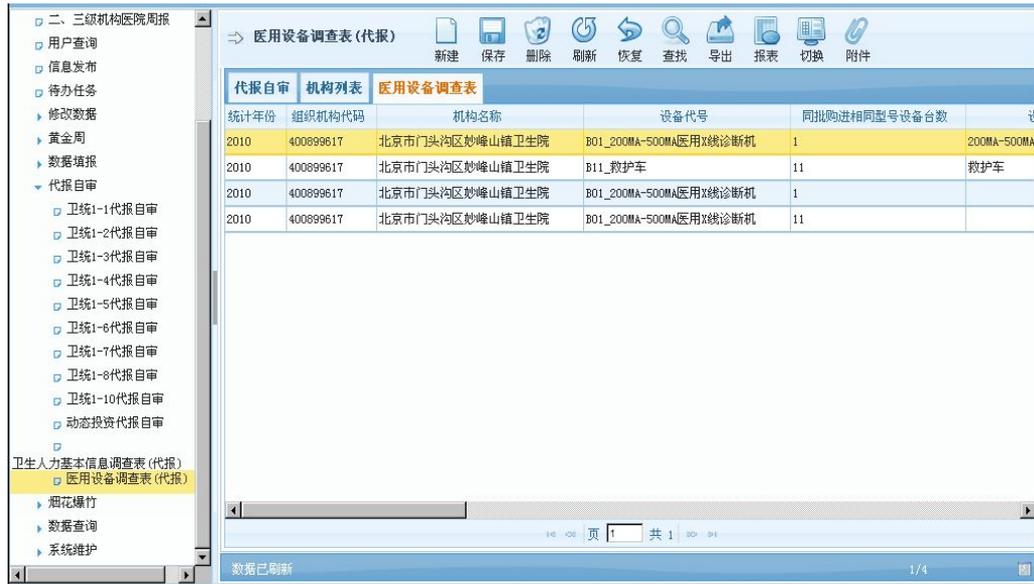


图 3-6 数据填报

7. 点击“新建”按钮，可添加一条新数据，如图 3-7 所示：

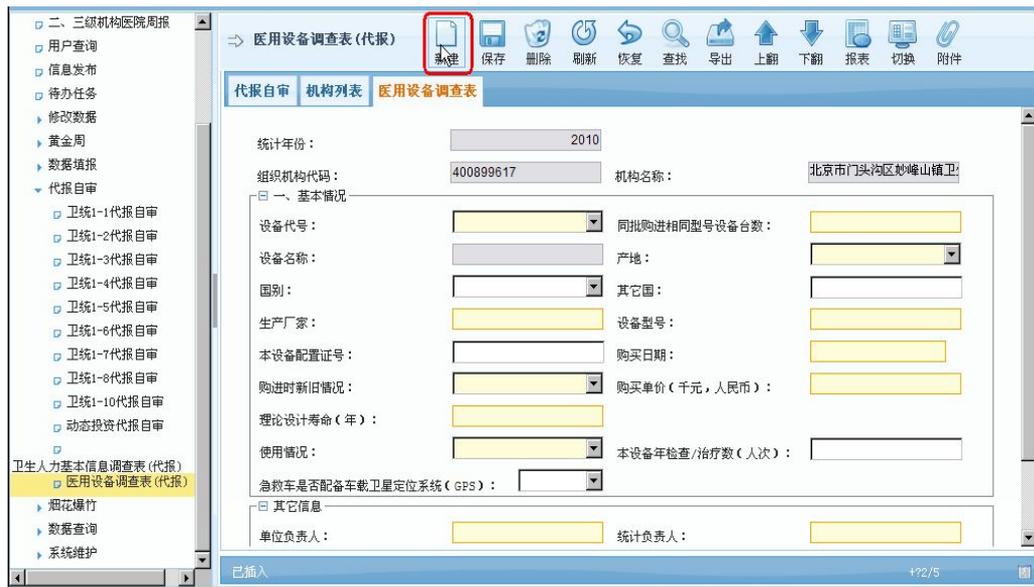


图 3-7 数据填报

8. 进入填报页面，（注：黄色为必填项，白色为非必填项，灰色不需要填写）。如图 3-8 所示：

统计年份: 2010
 组织机构代码: 400899617 机构名称: 北京市门头沟区妙峰山镇卫...
 一、基本情况
 设备代号: B03_呼吸机 同批购进相同型号设备台数:
 设备名称: 呼吸机 产地:
 围别: 3_德国 其它围:
 生产厂家: 浩浩 设备型号:
 本设备配置证号: 购买日期:
 购进时新旧情况: 1_新设备 购买单价(千元,人民币):
 理论设计寿命(年): 5
 使用情况: 1_启用 本设备年检查/治疗数(人次):
 急救车是否配备车载卫星定位系统(GPS):
 其它信息
 单位负责人: 统计负责人:

图 3-8 数据填报

9. 填写完毕后, 点击“保存”按钮。如图 3-9 所示:

统计年份: 2010
 组织机构代码: 400899617 机构名称: 北京市门头沟区妙峰山镇卫...
 一、基本情况
 设备代号: B03_呼吸机 同批购进相同型号设备台数: 2
 设备名称: 呼吸机 产地: 2_国产/合资
 围别: 3_德国 其它围:
 生产厂家: 浩浩 设备型号: 456
 本设备配置证号: 购买日期: 2010-05-01 15:30:34
 购进时新旧情况: 1_新设备 购买单价(千元,人民币): 100
 理论设计寿命(年): 5
 使用情况: 1_启用 本设备年检查/治疗数(人次): 5655
 急救车是否配备车载卫星定位系统(GPS):
 其它信息
 单位负责人: 浩浩 统计负责人: 立国
 填报人: 莉莉 联系电话: 01083531111
 报出日期: 2010-05-05 15:31:27

图 3-9 数据填报

10. 如填报的数据存在问题, 系统将给予提示, 如图 3-10 所示:

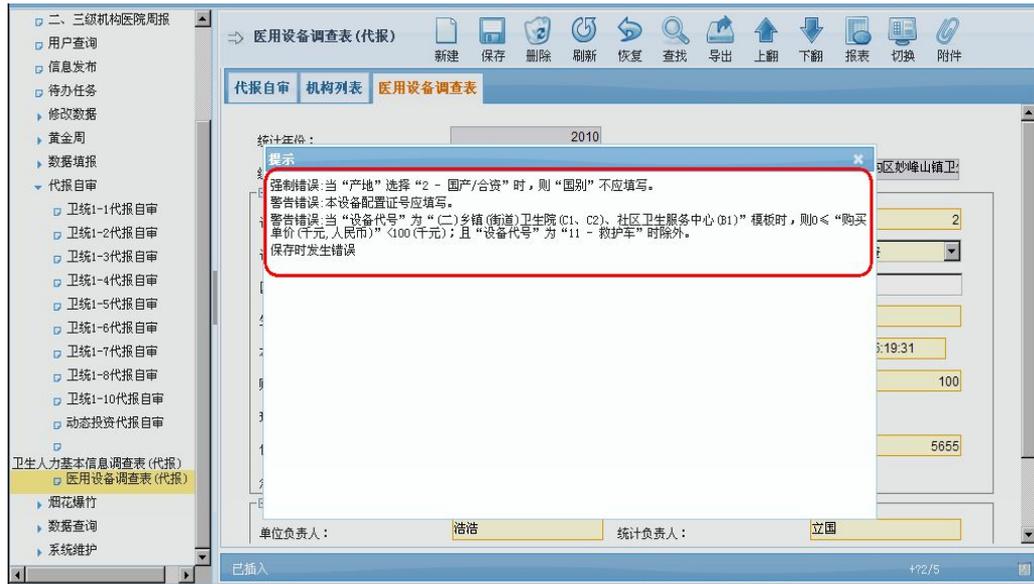


图 3-10 数据填报

11. 请按照提示再核查并进行修改。如图 3-11 所示:

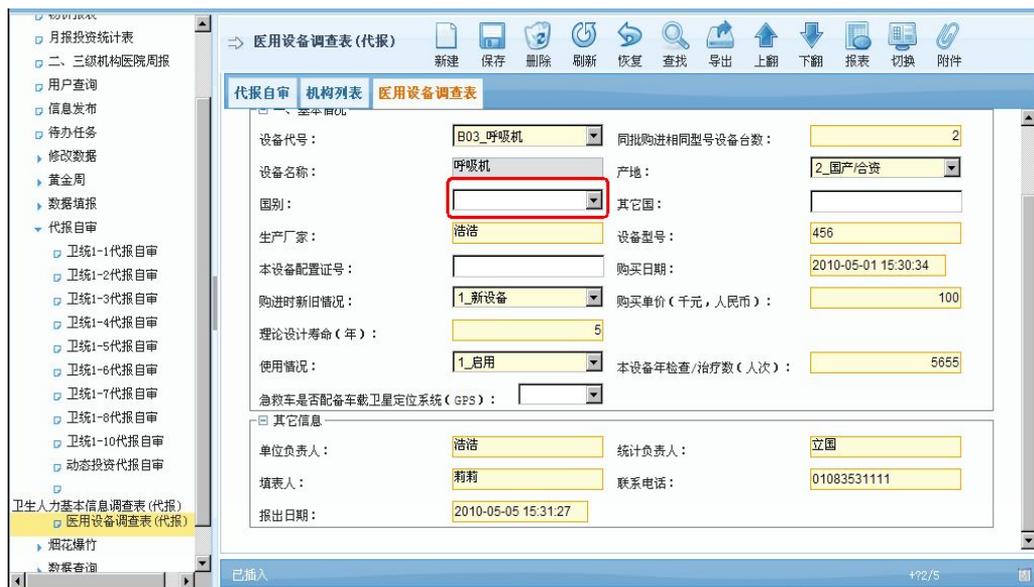


图 3-11 数据填报

12. 确认数据无误后, 再次点击“保存”按钮, 如没有错误, 系统将提示“记录已保存”。(保存成功, 中心端就可以看到数据), 如图 3-12 所示:

统计年份: 2010

组织机构代码: 400899617 机构名称: 北京市门头沟区妙峰山镇卫

设备代号: B03_呼吸机 同批购进相同型号设备台数: 2

设备名称: 呼吸机 产地: 2_国产合资

生产厂家: 浩洁 设备型号: 456

本设备配置证号: 购买日期: 2010-5-1 15:30:34

购进时新旧情况: 1_新设备 购买单价(千元,人民币): 100

理论设计寿命(年): 5

使用情况: 1_启用 本设备年检查/治疗数(人次): 5655

急救车是否配备车载卫星定位系统(GPS):

单位负责人: 浩洁 统计负责人: 立国

记录并保存

图 3-12 数据填报

13. 如需修改已填写的数据, 首先选中要修改的数据, 再点击“切换”按钮。如图 3-13 所示:

统计年份	组织机构代码	机构名称	设备代号	同批购进相同型号设备台数	设备名称
2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B01_200MA-500MA医用X线诊断机	1	200MA-500MA
2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B03_呼吸机	2	呼吸机
2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B11_救护车	11	救护车
2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B01_200MA-500MA医用X线诊断机	1	
2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B01_200MA-500MA医用X线诊断机	11	

切换

图 3-13 数据填报

14. 修改完数据后, 点击“保存”按钮。如图 3-14 所示:

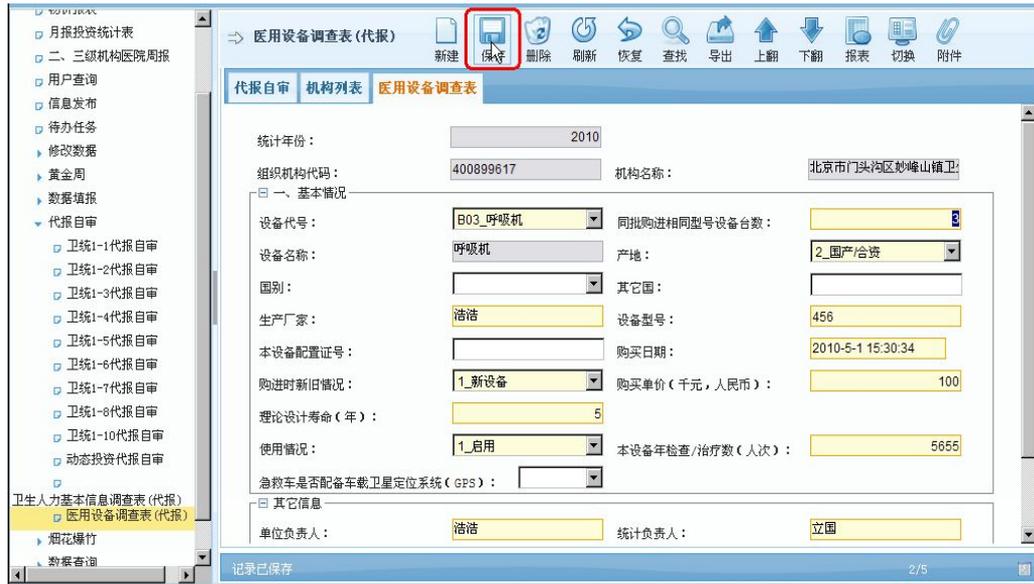


图 3-14 数据填报

15. 如果系统提示“记录已保存”，表明数据修改成功，(保存成功，中心端就可以看到数据)。如图 3-15 所示：

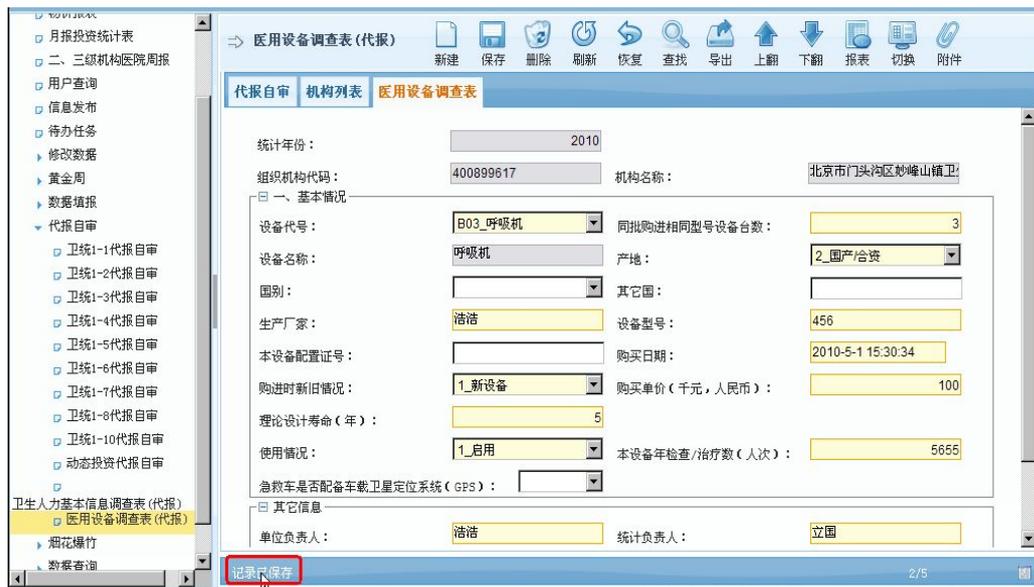


图 3-15 数据填报

3.2 数据查找

1. 当用户要对特定机构进行数据修改时，可使用查找功能，快速定位到目标机构，如图 3-16 所示：

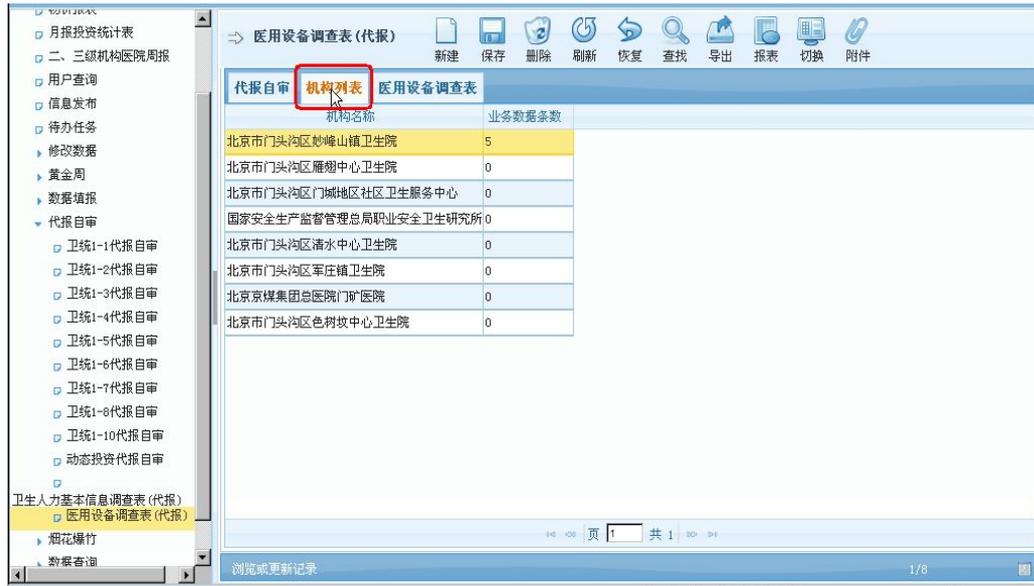


图 3-16 医疗机构查找功能

2. 点击“查找”按钮，如图 3-17 所示：

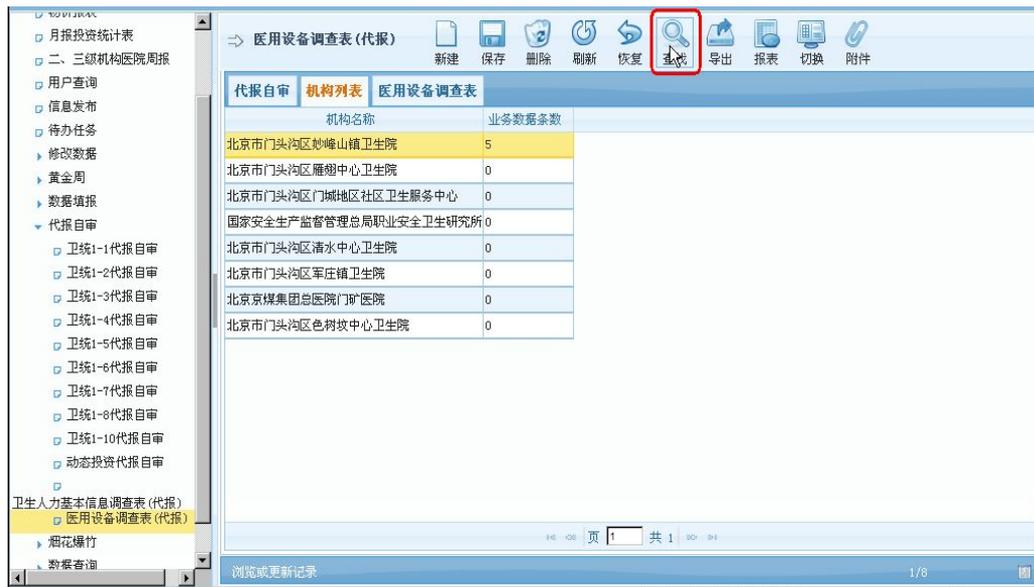


图 3-17 医疗机构查找功能

3. 在机构名称中填写要查找的机构全称，如图 3-18 所示：

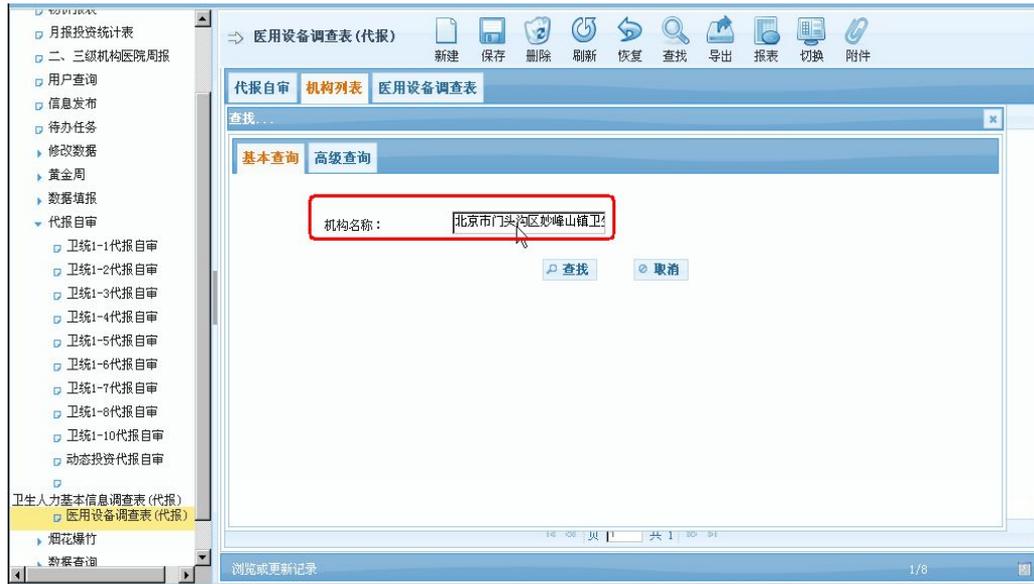


图 3-18 医疗机构查找功能

4. 确认输入的名称无误后，点击“查找”按钮，如图 3-19 所示：



图 3-19 医疗机构查找功能

5. 如该机构存在，页面将显示出相应数据，如图 3-20 所示：

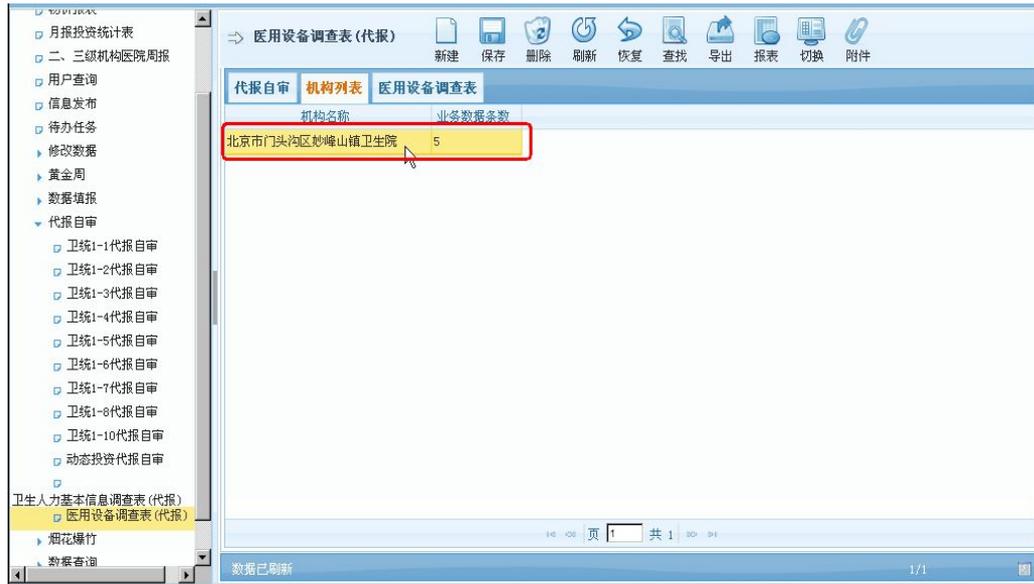


图 3-20 医疗机构查找功能

6. 如果输入的机构名称不存在，系统将提示没有相关数据。如图 3-21 所示：

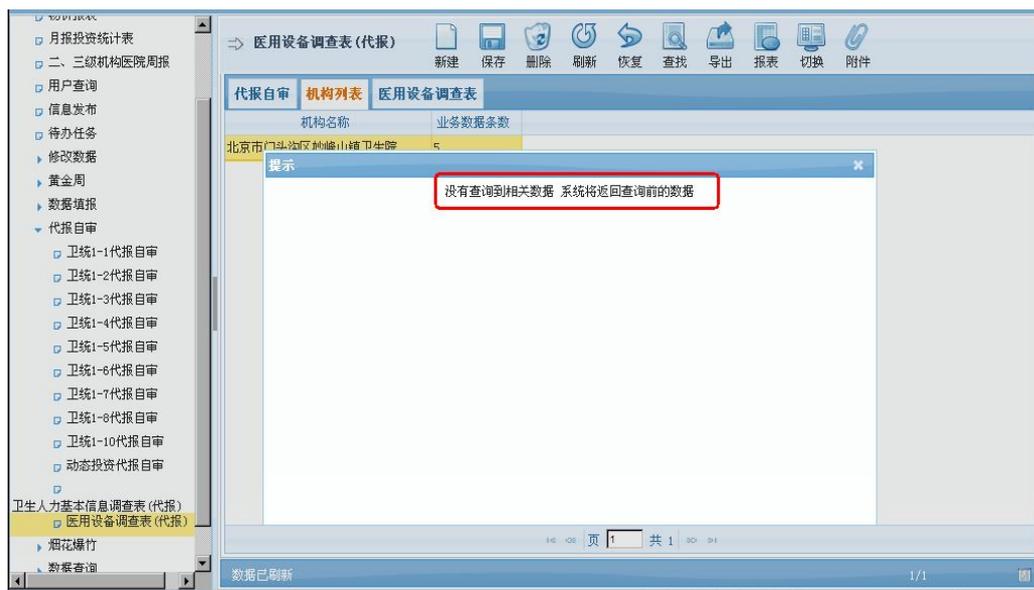


图 3-21 医疗机构查找功能

7. 也可以进行模糊查询,就是在查找的时候加% (注:%可以加在名称的前面部分,也可以加在名称的后面,还可以加在名称中间),如图 3-22 所示:

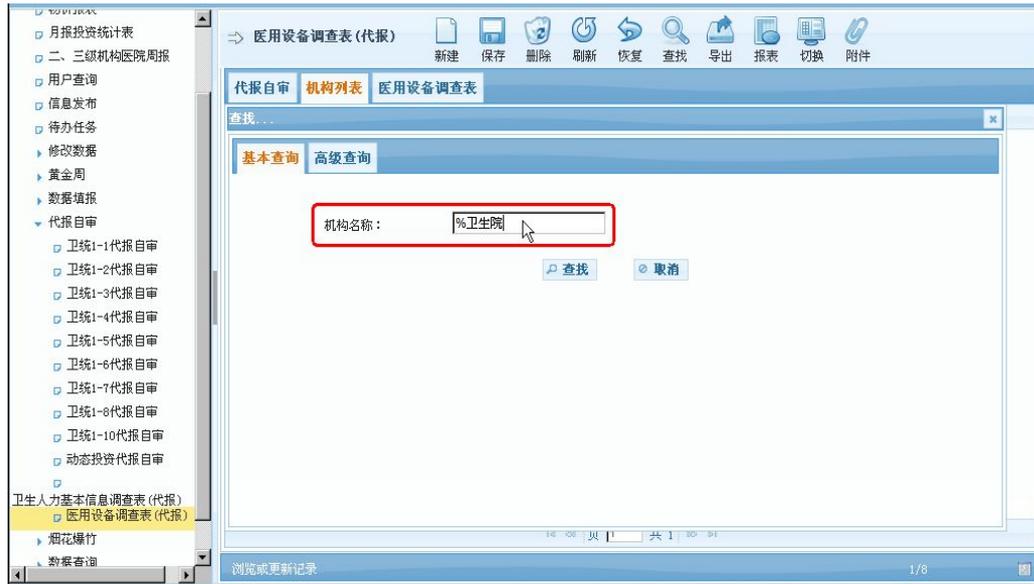


图 3-22 医疗机构查找功能

8. 点击“查找”按钮,如图 3-23 所示:



图 3-23 医疗机构查找功能

9. 查找到所有以“卫生院”三个字结尾的机构,如图 3-24 所示:



图 3-24 医疗机构查找功能

10. 如果输入的查询条件, 没有查到信息, 系统将提示没有相关数据, 如图 3-25 所示:

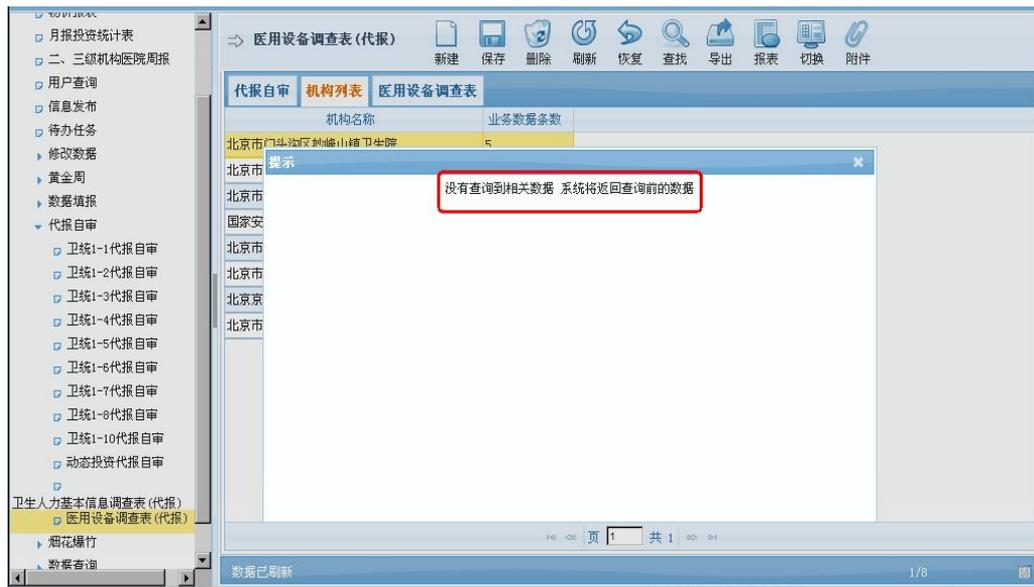


图 3-25 医疗机构查找功能

备注: 医用设备调查表页签, 也可以运用查找功能, 切换到医用设备调查表页签, 按设备名称查找, 查找步骤同上, 不再叙述。

第四章. 数据导出功能

4.1 数据在多行模式下导出

1. 在系统菜单中点击代报自审中的“医用设备调查表(代报)”，进入相应的页面。如图 4-1 所示：

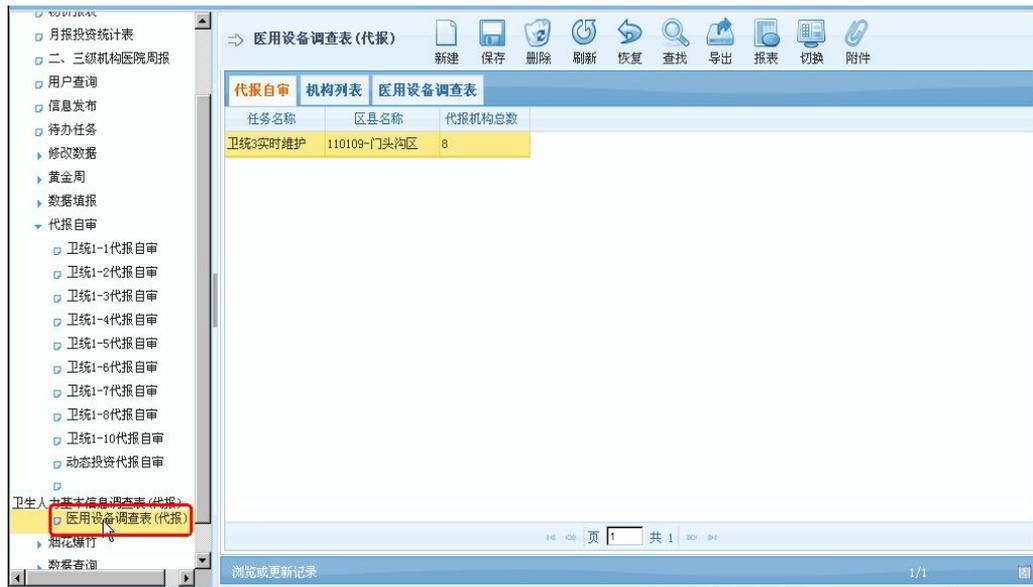


图 4-1 多行模式数据导出

2. 在“机构列表”页签中选中一家机构，点击“医用设备调查表”。如图 4-2 所示：



图 4-2 多行模式数据导出

3. 点击“导出”按钮，如图 4-3 所示：

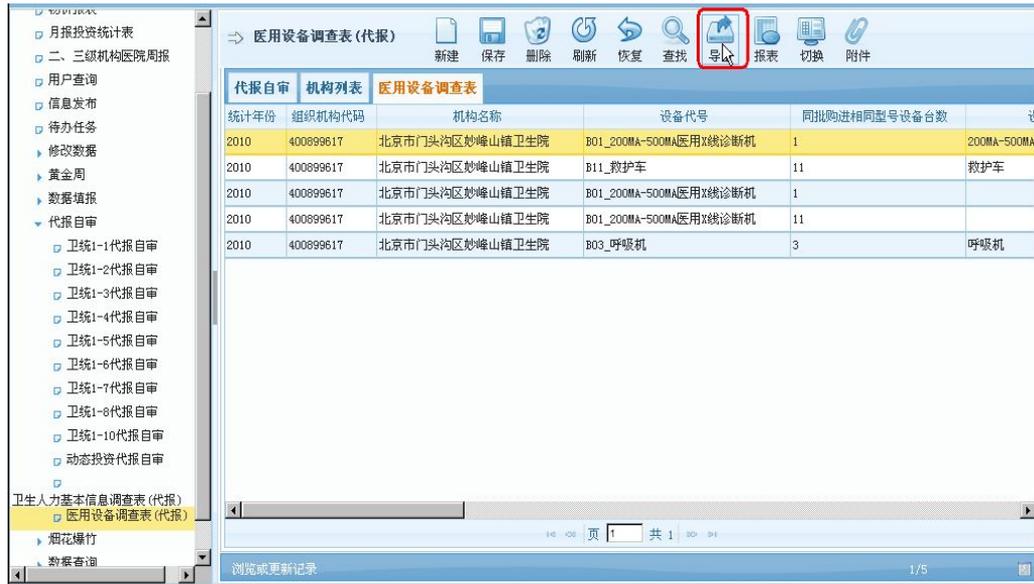


图 4-3 多行模式数据导出

4. 页面将弹出文件下载对话框，点击“保存”按钮，如图 4-4 所示：

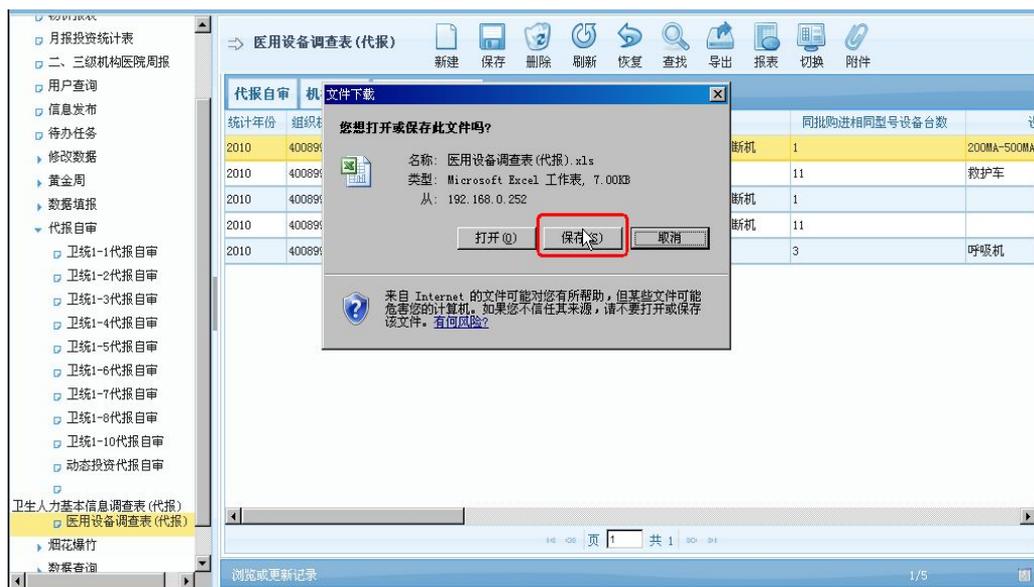


图 4-4 多行模式数据导出

5. 选择好本地目录后，点击“保存”按钮，文件可成功保存为 Excel 文件格式。如图 4-5 所示：



图 4-5 多行模式数据导出

6. 保存后可在本地打开查看 Excel 文件。如图 4-6 所示：

2	2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B01_200MA-500MA医用X线诊断机	1	200MA-500MA医用X线诊断机
3	2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B11_救护车	11	救护车
4	2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B01_200MA-500MA医用X线诊断机	1	
5	2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B01_200MA-500MA医用X线诊断机	11	
6	2010	400899617	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院	B03_呼吸机	3	呼吸机
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

图 4-6 多行模式数据导出

4.2 数据在单行模式下导出

1. 在系统菜单中点击代报自审中的“医用设备调查表(代报)”，进入相应的页面。如图 4-7 所示：

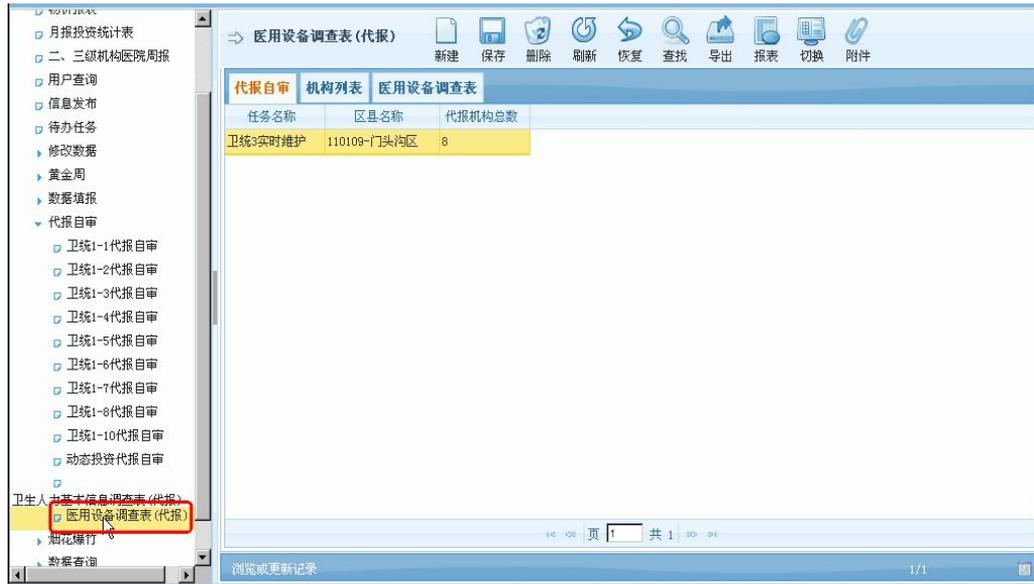


图 4-7 单行模式数据导出

2. 在“机构列表”页签中选中一家机构，点击“医用设备调查表”。如图 4-8 所示：



图 4-8 单行模式数据导出

3. 选择好要导出的数据，点击“切换”按钮。如图 4-9 所示：

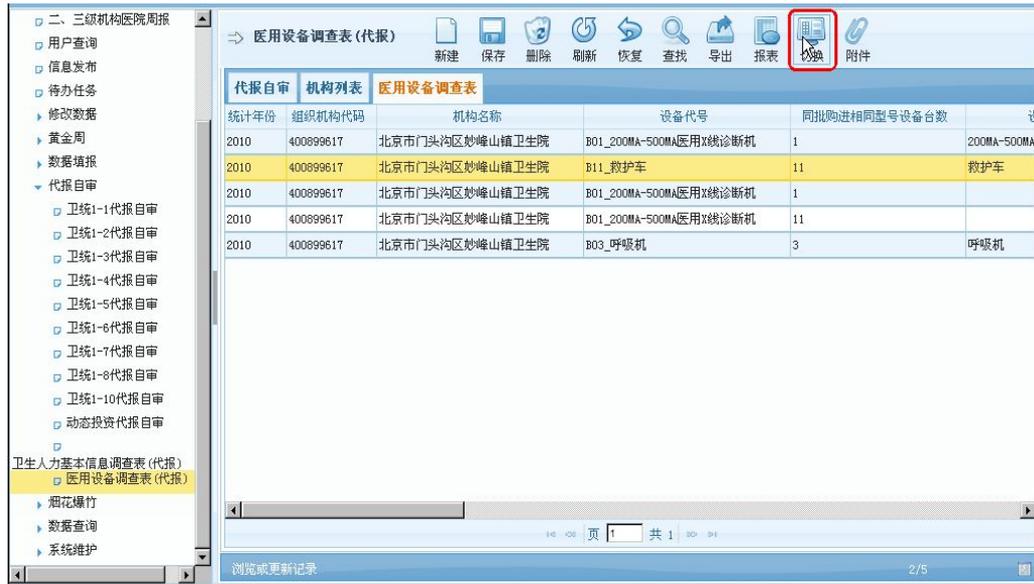


图 4-9 单行模式数据导出

4. 点击“导出”按钮，如图 4-10 所示：

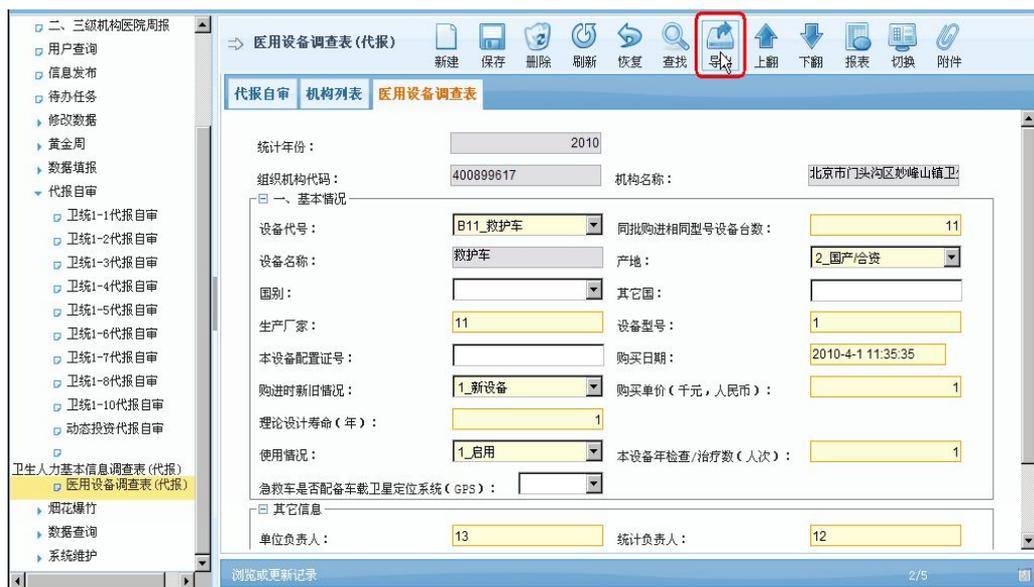


图 4-10 单行模式数据导出

5. 页面将弹出文件下载对话框，点击“保存”按钮，如图 4-11 所示：

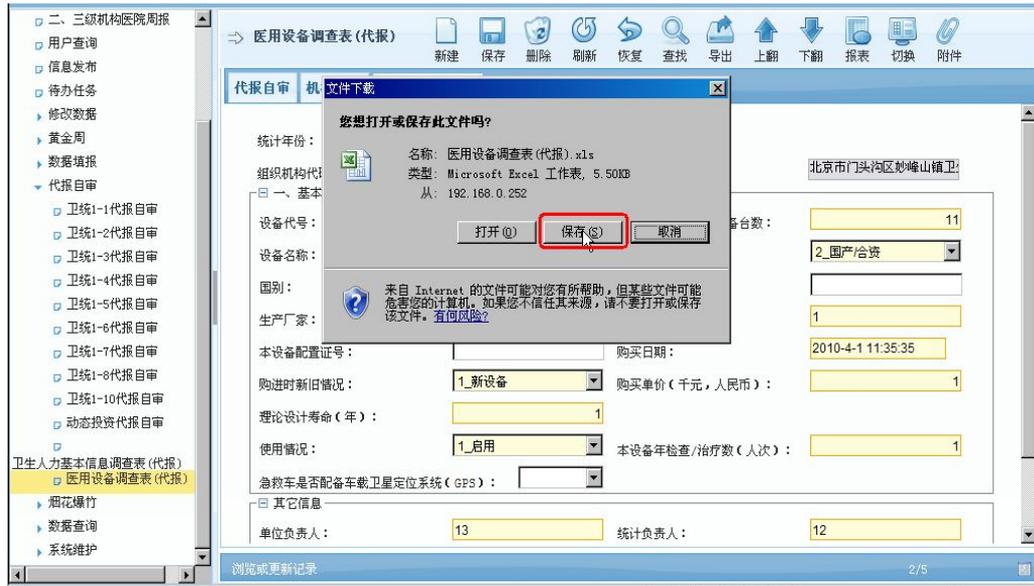


图 4-11 单行模式数据导出

6. 选择保存路径后，点击“保存”按钮，如图 4-12 所示：



图 4-12 单行模式数据导出

7. 保存后可在本地打开查看 Excel 文件。如图 4-13 所示：

	A	B	C	D	E	F	G
1	医用设备调查表						
2	统计年份	2010					
3	组织机构代码	400899617	机构名称	北京市门头沟区妙峰山镇卫生院			
4	设备代号	B11_救护车	同批购进相同型号设备台数	11			
5	设备名称	救护车	产地	2_国产/合资			
6	国别		其它国				
7	生产厂家	11	设备型号	1			
8	本设备配置证号		购买日期	2010-4-1 11:35:35			
9	购进时新旧情况	1_新设备	购买单价(千元,人民币)	1			
10	理论设计寿命(年)	1					
11	使用情况	1_启用	本设备年检查/治疗数(人次)	1			
12	急救车是否配备车载卫星定位系统(GPS)						
13	单位负责人	13	统计负责人	12			
14	填报人	1	联系电话	1			
15	报出日期	2010-4-1 11:35:46					
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

图 4-13 单行模式数据导出

第五章. 其它注意事项

1. 医用设备调查表的填报过程为实时上报，数据填写完毕后执行保存操作即可，无需单独进行上报操作。
2. 保存后，如果系统提示当前的数据仅存在警告错误时，数据已保存且上报成功。用户可根据实际情况，选择性的对数据进行修改。
3. 保存后，如果系统提示当前的数据存在强制错误时，用户必须按照提示内容对数据进行修改。