

# 综合统计平台医用设备调查表

## (直报)

## (医院端)

---

---

## 用户操作手册

北京万兴新锐科技发展有限公司  
2010 年 5 月

## 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章. 系统简介 .....     | 3  |
| 1.1 系统常用图标.....     | 3  |
| 第二章. 系统登录 .....     | 4  |
| 2.1 系统登录.....       | 4  |
| 第三章. 数据填报与查找 .....  | 6  |
| 3.1 数据填报 .....      | 6  |
| 3.2 数据查找 .....      | 11 |
| 第四章. 数据导出功能 .....   | 17 |
| 4.1 数据在多行模式下导出..... | 17 |
| 4.2 数据在单行模式下导出..... | 20 |
| 第五章. 其它注意事项 .....   | 24 |

# 第一章. 系统简介

## 1.1 系统常用图标

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 新建一条信息         |
|    | 保存信息           |
|    | 可以删除选中的那条信息    |
|    | 刷新页面           |
|   | 恢复到前一个页面       |
|  | 查找机构信息         |
|  | 导入模板           |
|  | 以 Excel 形式导出保存 |
|  | 上一条数据          |
|  | 下一条数据          |
|  | 切换到明细页面        |
|  | 下载附件           |

## 第二章. 系统登录

### 2.1 系统登录

1. 在 IE 地址栏输入地址：http://210.75.201.217/bjhbstat，点击“转入”按钮。如图 2-1 所示：

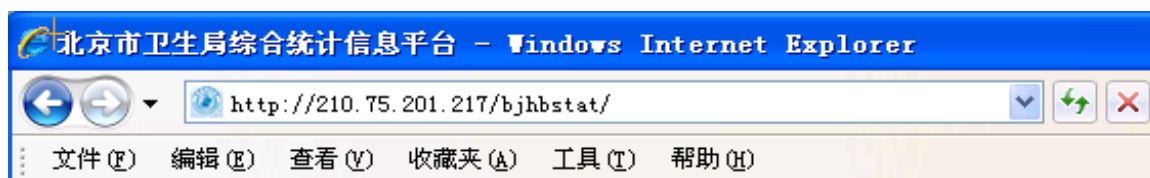


图 2-1 转换界面

2. 进入系统登录界面。如图 2-2 所示：



图 2-2 登录界面



图 2-3 系统登录

3. 成功登陆。如图 2-4 所示：

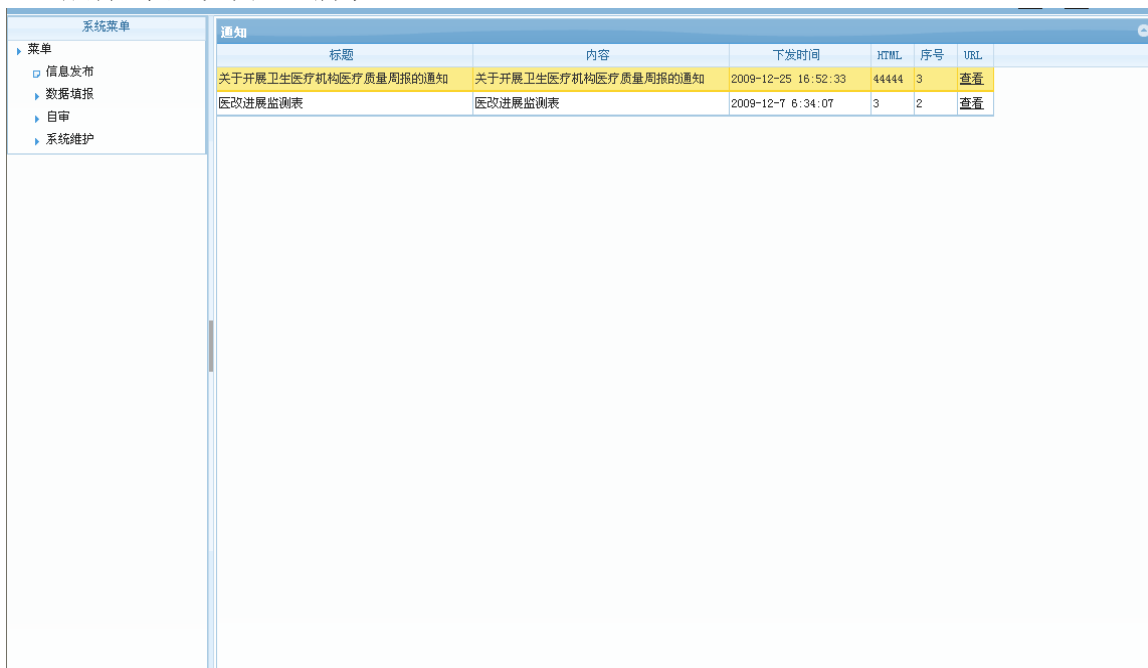


图 2-4 系统登陆

## 第三章. 数据填报与查找

### 3.1 数据填报

1. 在系统菜单中点击数据填报中的“医用设备调查表(数据填报)”，进入相应的页面。如图 3-1 所示：

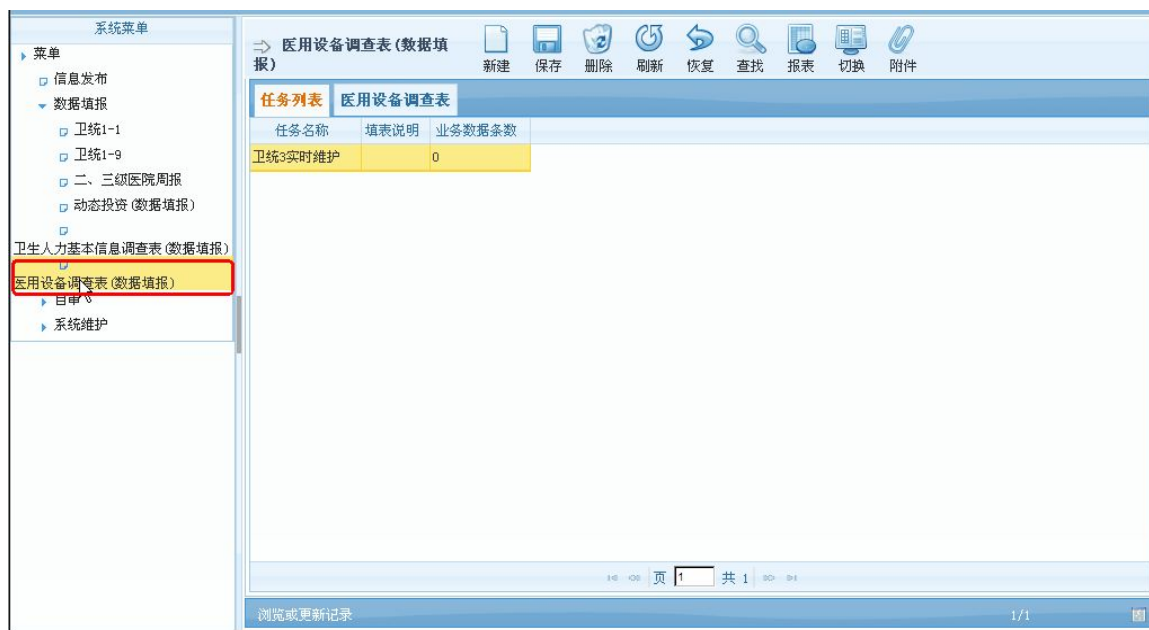


图 3-1 数据填报

2. 在页面上点击“医用设备调查表”，进入相应页面。如图 3-2 所示：

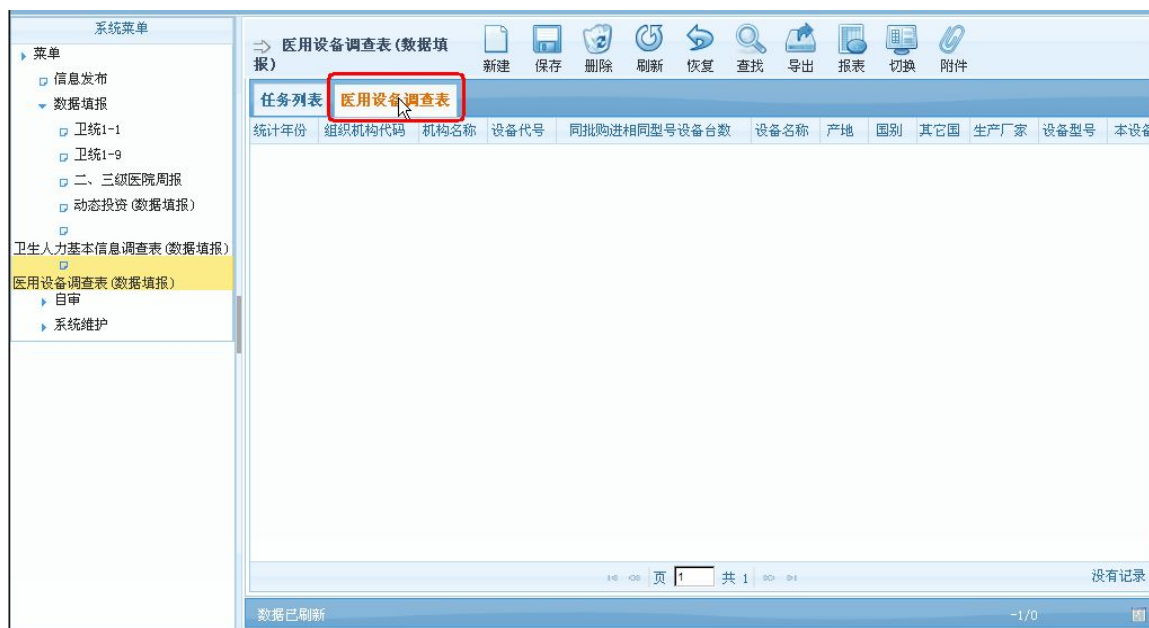


图 3-2 数据填报

3. 在“医用设备调查表”页面中显示该医疗机构的医用设备调查表的明细项目（**该机构医用设备调查表为零**），用户可进行数据新建、数据修改的相关操作。如图 3-3 所示：

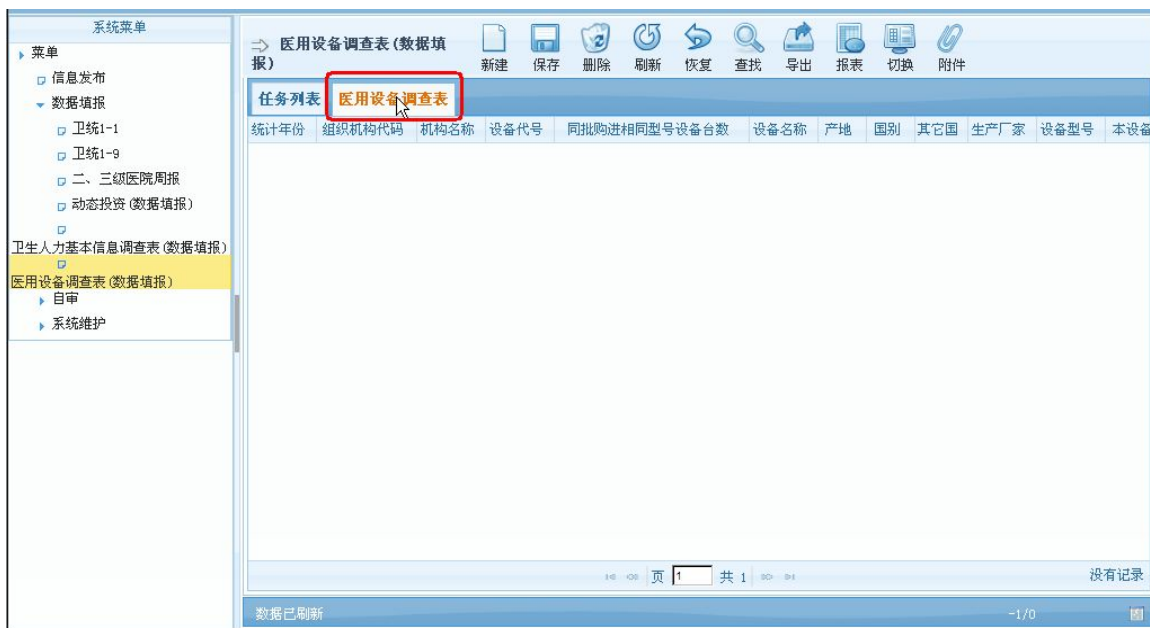


图 3-3 数据填报

4. 点击“新建”按钮，添加一条新数据。如图 3-4 所示：

图 3-4 数据填报

5. 在数据填报页面中进行数据填报，（注：黄色为必填项，白色为非必填项，灰色为系统自动带出不需要填写），如图 3-5 所示：

系统菜单

- 菜单
  - 信息发布
  - 数据填报
    - 卫统1-1
    - 卫统1-9
    - 二、三级医院周报
    - 动态投资 (数据填报)
  - 卫生人力基本信息调查表 (数据填报)
  - 医用设备调查表 (数据填报)
    - 自审
    - 系统维护

任务列表 医用设备调查表

统计年份: 2010

组织机构代码: 400899481 机构名称: 北京市门头沟区龙泉医院

一、基本情况

设备代号: [Empty] 同批购进相同型号设备台数: [Empty]

设备名称: [Empty] 产地: [Empty]

国别: [Empty] 其它国: [Empty]

生产厂家: [Empty] 设备型号: [Empty]

本设备配置证号: [Empty] 购买日期: [Empty]

购进时新旧情况: [Empty] 购买单价 (千元, 人民币): [Empty]

理论设计寿命 (年): [Empty]

使用情况: [Empty] 本设备年检查/治疗数 (人次): [Empty]

急救车是否配备车载卫星定位系统 (GPS): [Empty]

其它信息

单位负责人: [Empty] 统计负责人: [Empty]

已插入 +71/1

图 3-5 数据填报

6. 数据填写完成后, 点击“保存”按钮。如图 3-6 所示:

系统菜单

- 菜单
  - 信息发布
  - 数据填报
    - 卫统1-1
    - 卫统1-9
    - 二、三级医院周报
    - 动态投资 (数据填报)
  - 卫生人力基本信息调查表 (数据填报)
  - 医用设备调查表 (数据填报)
    - 自审
    - 系统维护

任务列表 医用设备调查表

一、基本情况

设备代号: A22\_牙科综合治疗台 同批购进相同型号设备台数: 2

设备名称: 牙科综合治疗台 产地: 1\_进口

国别: 2\_美国 其它国: [Empty]

生产厂家: 联邦 设备型号: 456

本设备配置证号: [Empty] 购买日期: [Empty]

购进时新旧情况: 1\_新设备 购买单价 (千元, 人民币): 4592

理论设计寿命 (年): 16

使用情况: 1\_启用 本设备年检查/治疗数 (人次): 5000

急救车是否配备车载卫星定位系统 (GPS): [Empty]

其它信息

单位负责人: 林立新 统计负责人: 李梅

填报人: 莉莉 联系电话: 01083531111

报出日期: 2010-05-05 10:38:06

已插入 +71/1

图 3-6 数据填报

7. 数据保存成功, 系统则显示“记录已保存” (保存成功, 中心端就可以看到数据)。如图 3-7 所示:

系统菜单

- 菜单
  - 信息发布
  - 数据填报
    - 卫统1-1
    - 卫统1-9
    - 二、三级医院周报
    - 动态投资 (数据填报)
    - 卫生人力基本信息调查表 (数据填报)
    - 医用设备调查表 (数据填报)
      - 自审
      - 系统维护

医用设备调查表 (数据填报)

新建 保存 删除 刷新 恢复 查找 导出 上翻 下翻 报表 切换 附件

任务列表 医用设备调查表

统计年份: 2010

组织机构代码: 400899481 机构名称: 北京市门头沟区龙泉医院

一、基本情况

设备代号: A22\_牙科综合治疗台 同批购进相同型号设备台数: 2

设备名称: 牙科综合治疗台 产地: 1\_进口

国别: 2\_美国 其它国:

生产厂家: 联邦 设备型号: 456

本设备配置证号: 购买日期: 2010-5-1 10:40:10

购进时新旧情况: 1\_新设备 购买单价 (千元, 人民币): 4592

理论设计寿命 (年): 16

使用情况: 1\_启用 本设备年检查/治疗数 (人次): 5000

急救车是否配备车载卫星定位系统 (GPS):

其它信息

单位负责人: 林立新 统计负责人: 李梅

记录已保存

图 3-7 数据填报

8. 如果填报的数据有错误，系统会出现相应的错误提示。如图 3-8 所示：

系统菜单

- 菜单
  - 信息发布
  - 数据填报
    - 卫统1-1
    - 卫统1-9
    - 二、三级医院周报
    - 动态投资 (数据填报)
    - 卫生人力基本信息调查表 (数据填报)
    - 医用设备调查表 (数据填报)
      - 自审
      - 系统维护

医用设备调查表 (数据填报)

新建 保存 删除 刷新 恢复 查找 导出 上翻 下翻 报表 切换 附件

任务列表 医用设备调查表

统计年份: 2010

提示

同批购进相同型号设备台数 必填

北京市门头沟区龙泉医院

设备代号: A22\_牙科综合治疗台 同批购进相同型号设备台数: 2

设备名称: 牙科综合治疗台 产地: 1\_进口

国别: 2\_美国 其它国:

生产厂家: 联邦 设备型号: 456

本设备配置证号: 购买日期: 2010-5-1 10:40:10

购进时新旧情况: 1\_新设备 购买单价 (千元, 人民币): 4592

理论设计寿命 (年): 16

使用情况: 1\_启用 本设备年检查/治疗数 (人次): 5000

急救车是否配备车载卫星定位系统 (GPS):

其它信息

单位负责人: 林立新 统计负责人: 李梅

记录已保存

图 3-8 数据填报

9. 可根据系统的错误提示进行数据修改，修改完成后再次保存数据即可。如图 3-9 所示：

图 3-9 数据填报

10. 如需修改已填写的数据，首先选中要修改的数据，再点击“切换”按钮。如图 3-10 所示：

图 3-10 数据填报

11. 修改完数据后，点击“保存”按钮。如图 3-11 所示：

系统菜单

- 菜单
- 信息发布
- 数据填报
  - 卫统1-1
  - 卫统1-9
  - 二、三级医院周报
  - 动态投资 (数据填报)
- 卫生人力基本信息调查表 (数据填报)
- 医用设备调查表 (数据填报)
  - 自审
  - 系统维护

医用设备调查表 (数据填报)

任务列表 医用设备调查表

统计年份: 2010

组织机构代码: 400899481 机构名称: 北京市门头沟区龙泉医院

一、基本情况

设备代号: A12\_钴60治疗机 同批购进相同型号设备台数: 10

设备名称: 钴60治疗机 产地: 1\_进口

国别: 4\_荷兰 其它国:

生产厂家: 飞飞 设备型号: 5

本设备配置证号: 购买日期: 2010-5-2 11:03:59

购进时新旧情况: 1\_新设备 购买单价 (千元, 人民币): 10000

理论设计寿命 (年): 5

使用情况: 1\_启用 本设备年检查/治疗数 (人次): 5000

急救车是否配备车载卫星定位系统 (GPS):

其它信息

单位负责人: 张力 统计负责人: 郝灵

浏览或更新记录 1/3

图 3-11 数据填报

12. 如果系统提示“记录已保存”，表明数据修改成功，(保存成功, 中心端就可以看到数据)。
- 如图 3-12 所示：

系统菜单

- 菜单
- 信息发布
- 数据填报
  - 卫统1-1
  - 卫统1-9
  - 二、三级医院周报
  - 动态投资 (数据填报)
- 卫生人力基本信息调查表 (数据填报)
- 医用设备调查表 (数据填报)
  - 自审
  - 系统维护

医用设备调查表 (数据填报)

任务列表 医用设备调查表

统计年份: 2010

组织机构代码: 400899481 机构名称: 北京市门头沟区龙泉医院

一、基本情况

设备代号: A12\_钴60治疗机 同批购进相同型号设备台数: 10

设备名称: 钴60治疗机 产地: 1\_进口

国别: 4\_荷兰 其它国:

生产厂家: 飞飞 设备型号: 5

本设备配置证号: 购买日期: 2010-5-2 11:03:59

购进时新旧情况: 1\_新设备 购买单价 (千元, 人民币): 10000

理论设计寿命 (年): 5

使用情况: 1\_启用 本设备年检查/治疗数 (人次): 5000

急救车是否配备车载卫星定位系统 (GPS):

其它信息

单位负责人: 张力 统计负责人: 郝灵

记录已保存 1/3

图 3-12 数据填报

## 3.2 数据查找

1. 当用户要对特定医用设备调查表进行数据修改时，可使用数据查找功能，可快速定位到目标数据，在系统菜单中点击数据填报中的“医用设备调查表 (数据填报)”，进入相应的页面。
- 如图 3-10 所示：

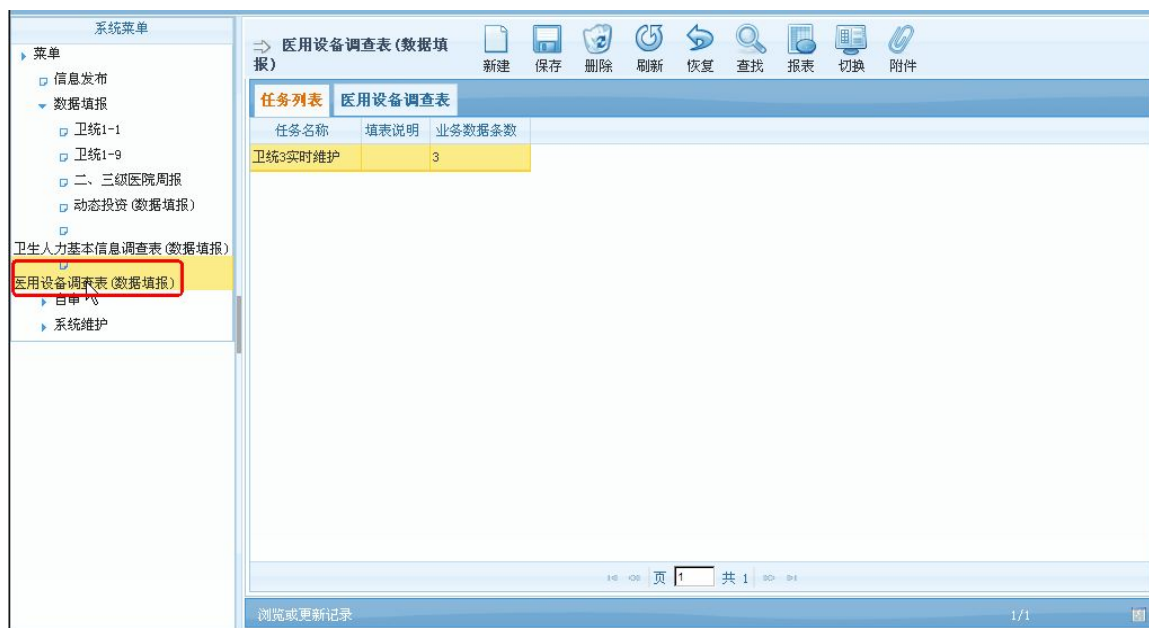


图 3-10 数据查找

2. 在页面上点击“医用设备调查表”，进入相应页面。如图 3-11 所示：

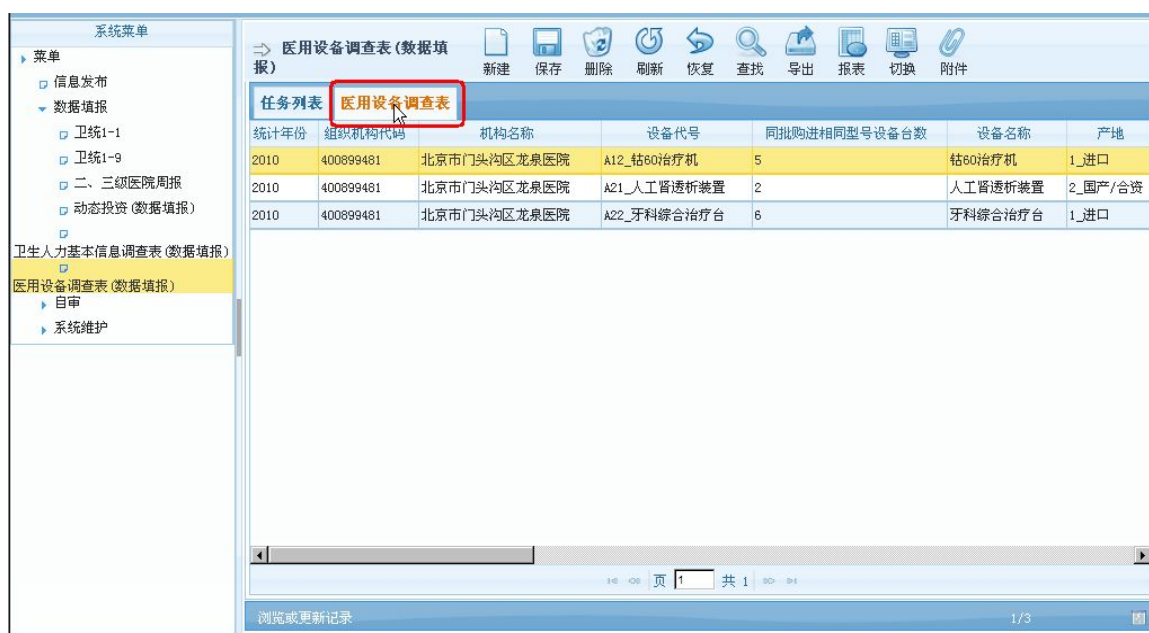


图 3-11 数据查找

3. 点击“查找”按钮。如图 3-12 所示：

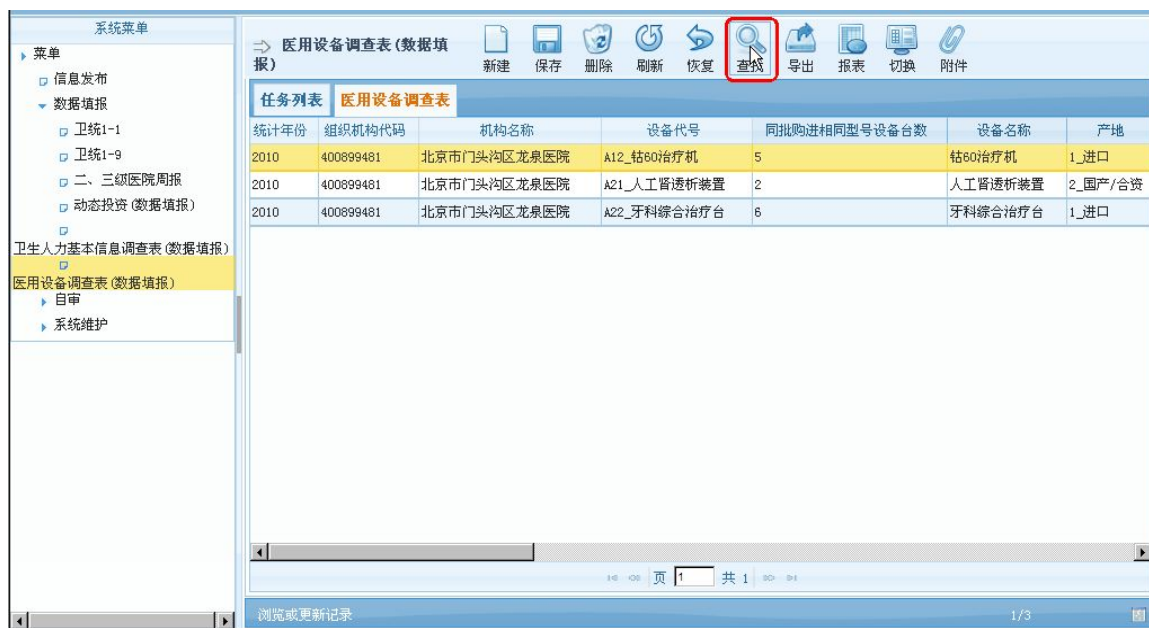


图 3-12 数据查找

4. 系统出现查找对话框。如图 3-13 所示：

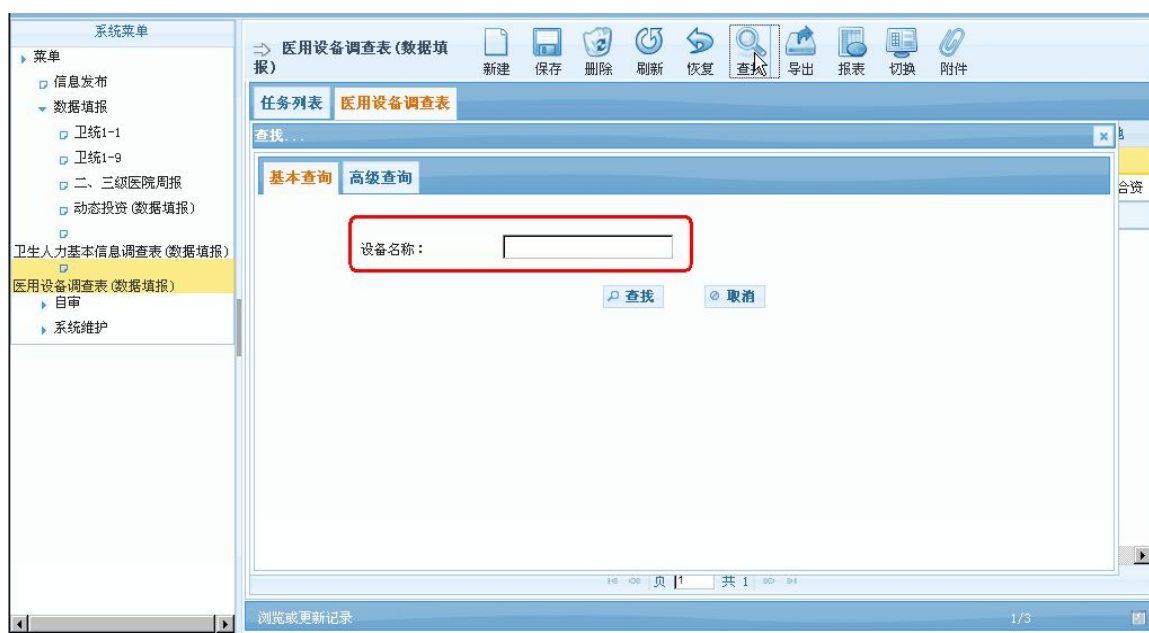


图 3-13 数据查找

5. 在查找对话框中填写要查找的设备名称。如图 3-14 所示：

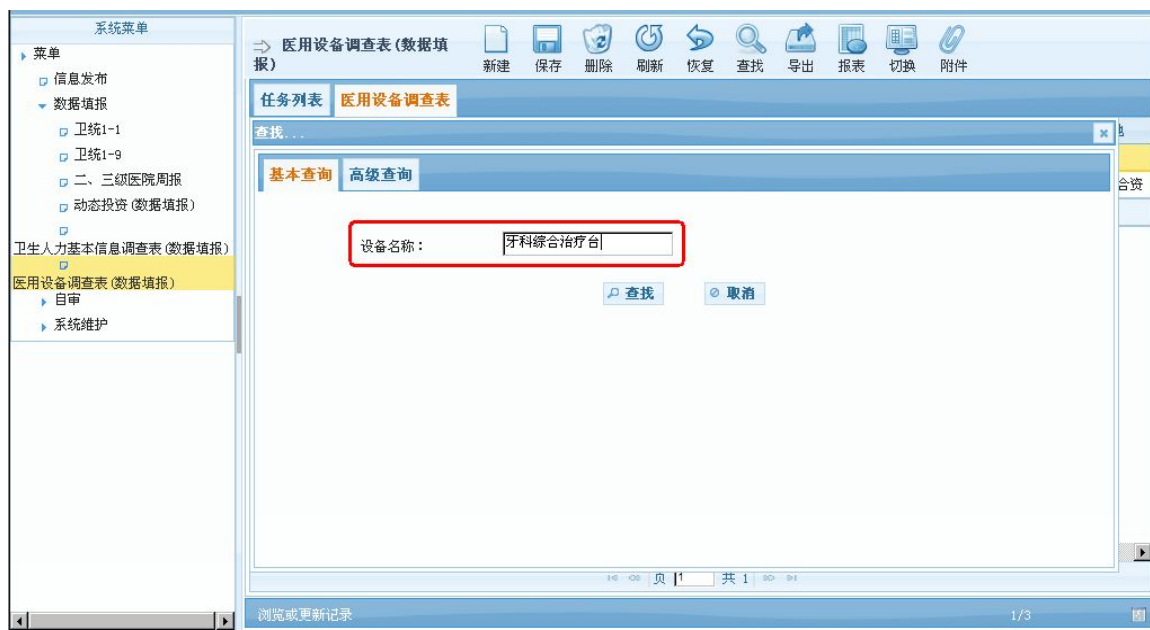


图 3-14 数据查找

6. 点击“查找”按钮。如图 3-15 所示：

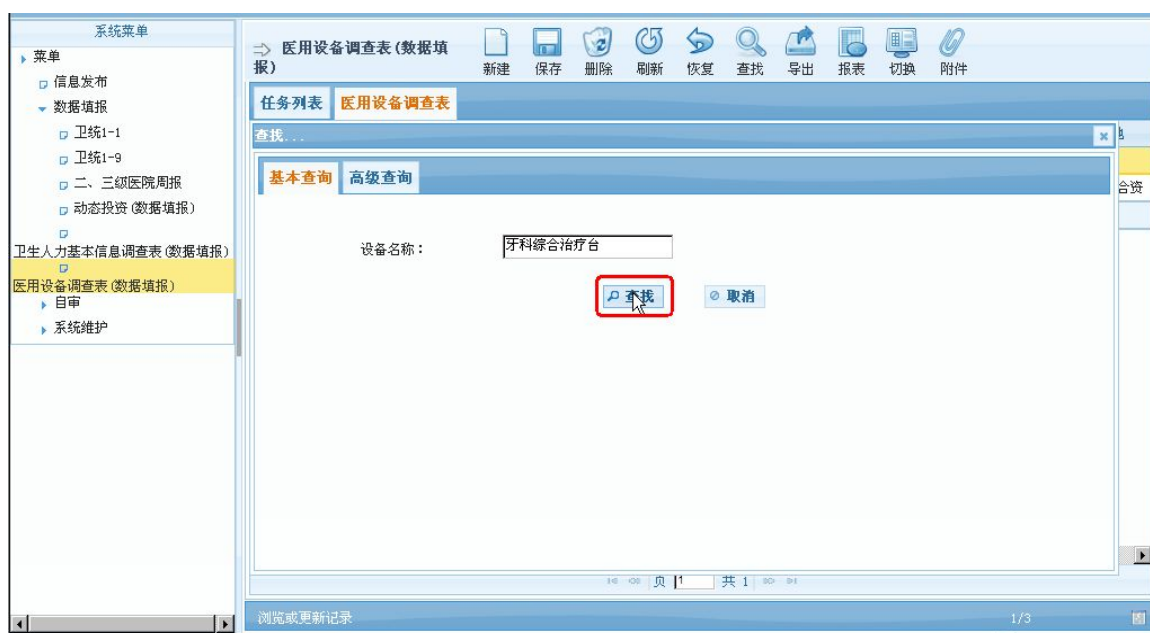


图 3-15 数据查找

7. 系统可查找到相应的数据。如图 3-16 所示：

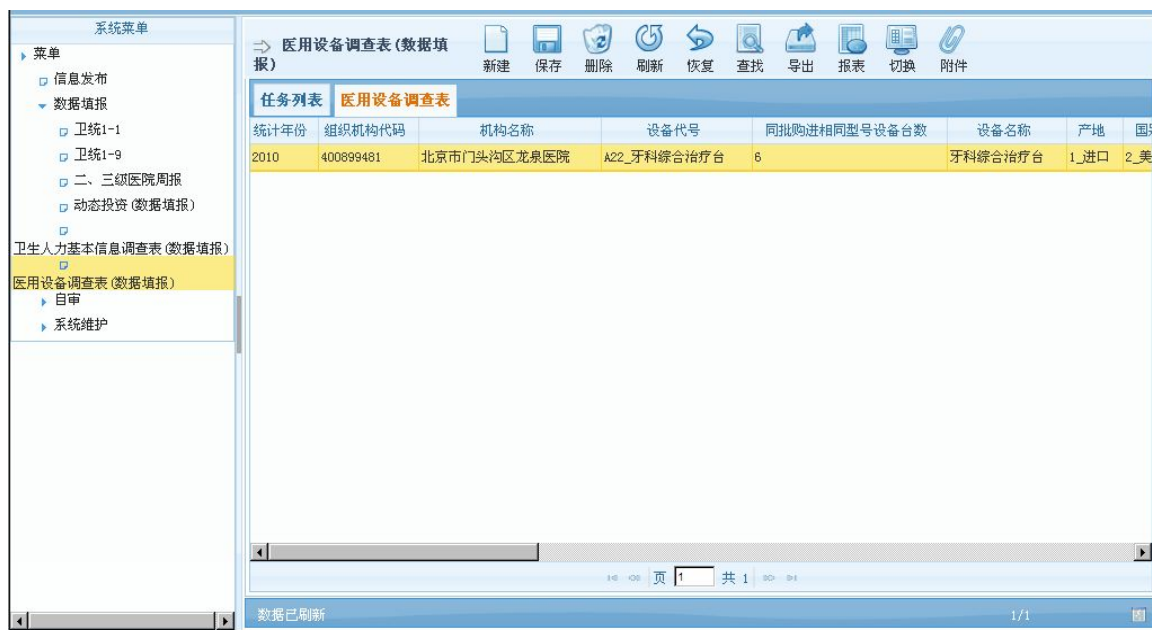


图 3-16 数据查找

8. 如果输入的姓名不存在, 则系统提示没有相关数据, 如图 3-17 所示:

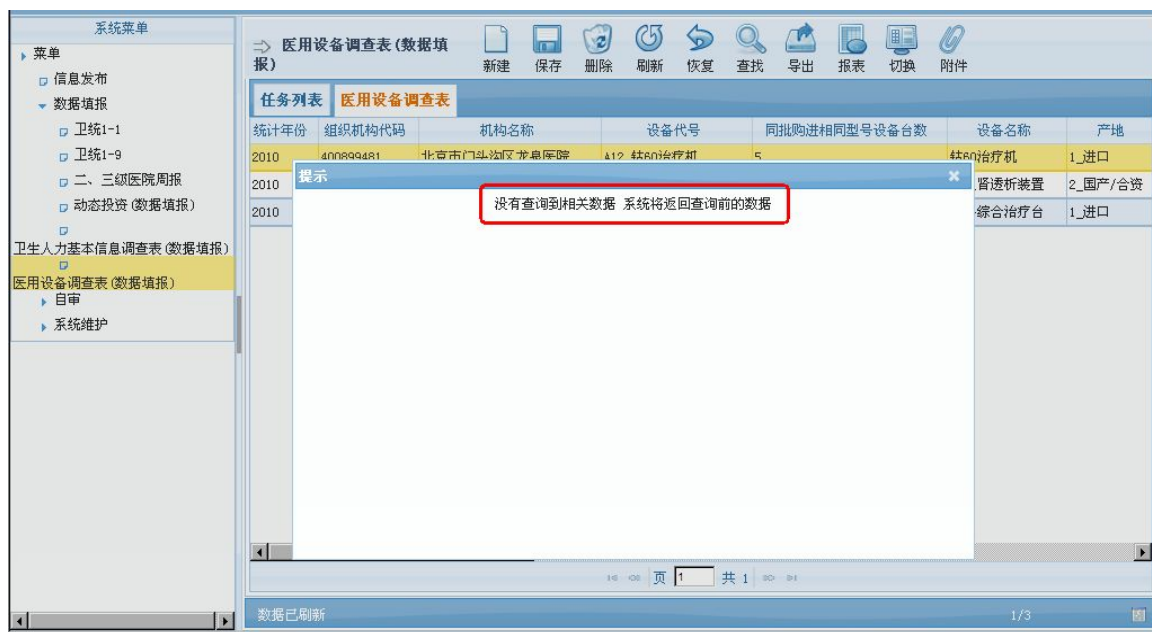


图 3-17 数据查找

9. 也可以进行模糊查询, 就是在查找的时候加% (注: %可以加在名称的前面部分, 也可以加在名称的后面, 还可以加在名称中间), 如图 3-18 所示:

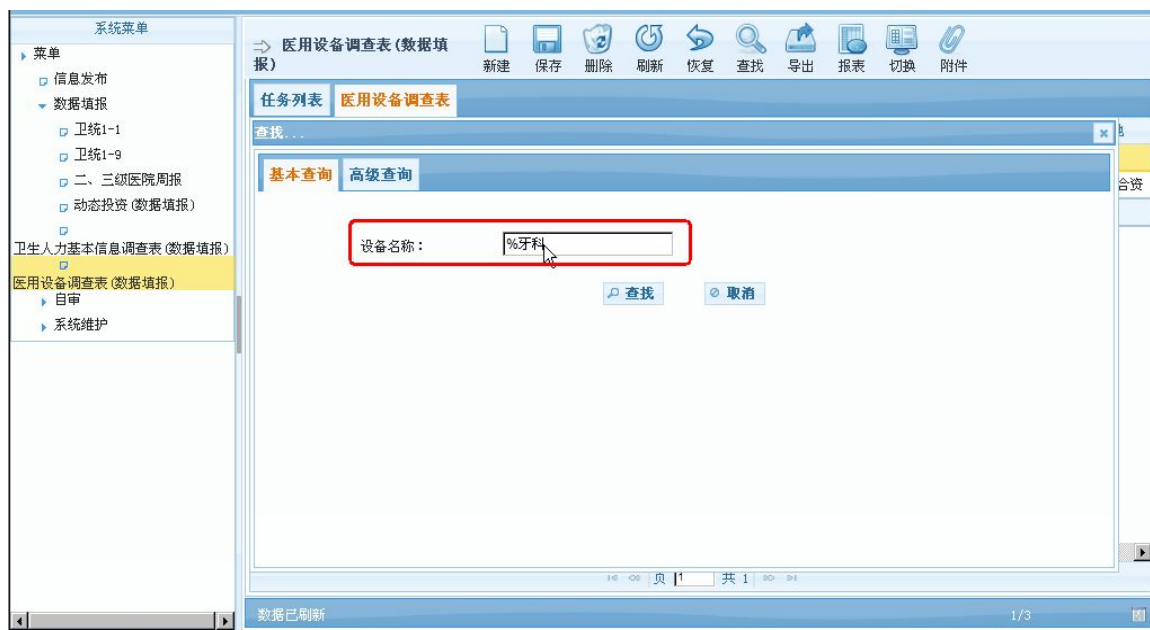


图 3-18 数据查找

10. 点击“查找”按钮,如图 3-19 所示:

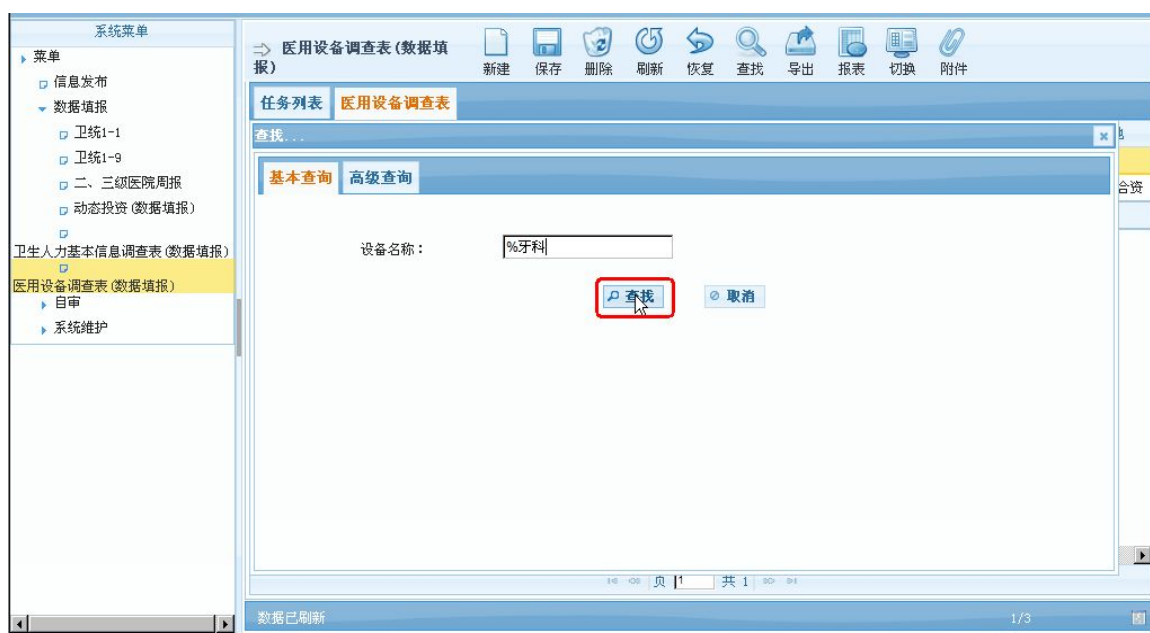


图 3-19 数据查找

11. 查找设备名称含有“牙科”两个字的调查表,如图 3-20 所示:

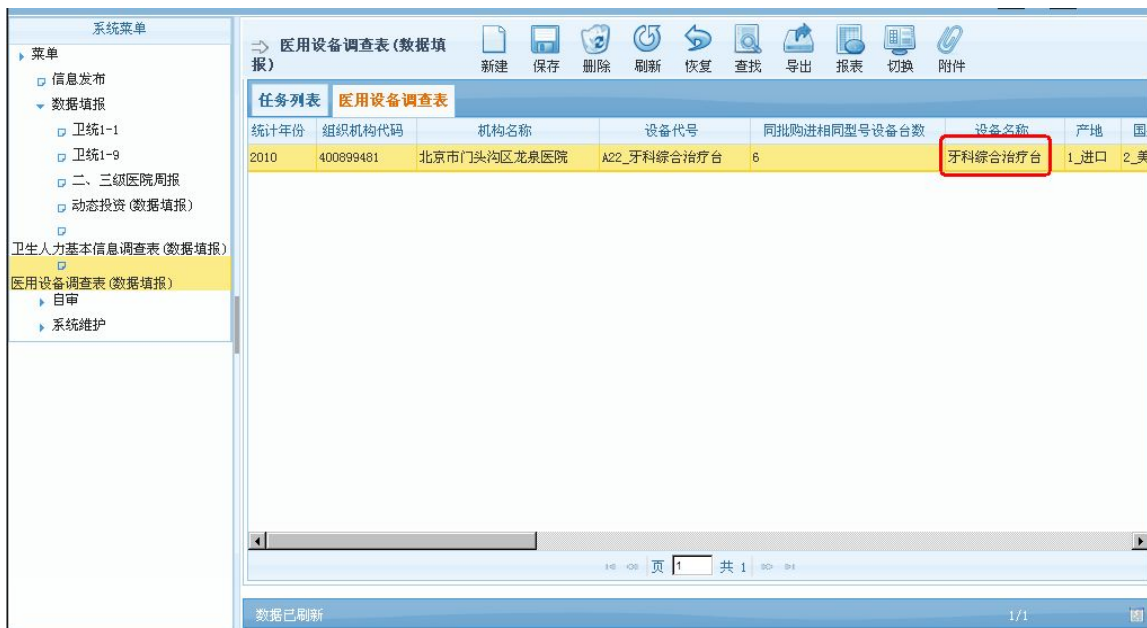


图 3-20 数据查找

12. 如果输入的查询条件, 没有查到信息, 系统将提示没有相关数据, 如图 3-21 所示:

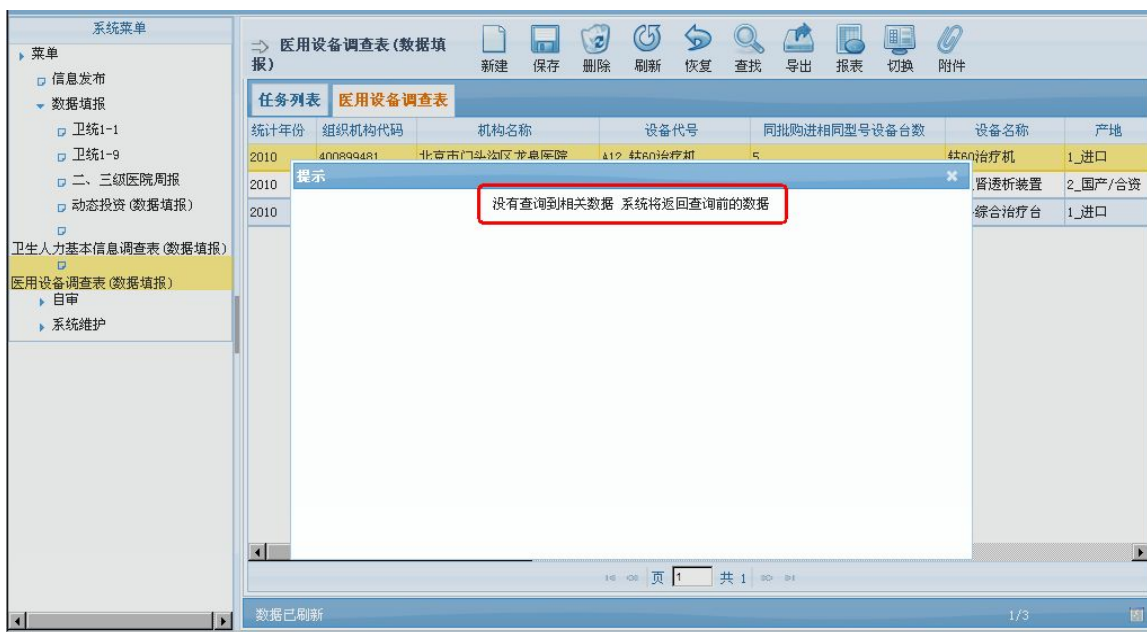


图 3-21 数据查找

## 第四章. 数据导出功能

### 4.1 数据在多行模式下导出

1. 在系统菜单中点击数据填报中的“医用设备调查表(数据填报)”, 进入相应的页面。如图 4-1 所示:

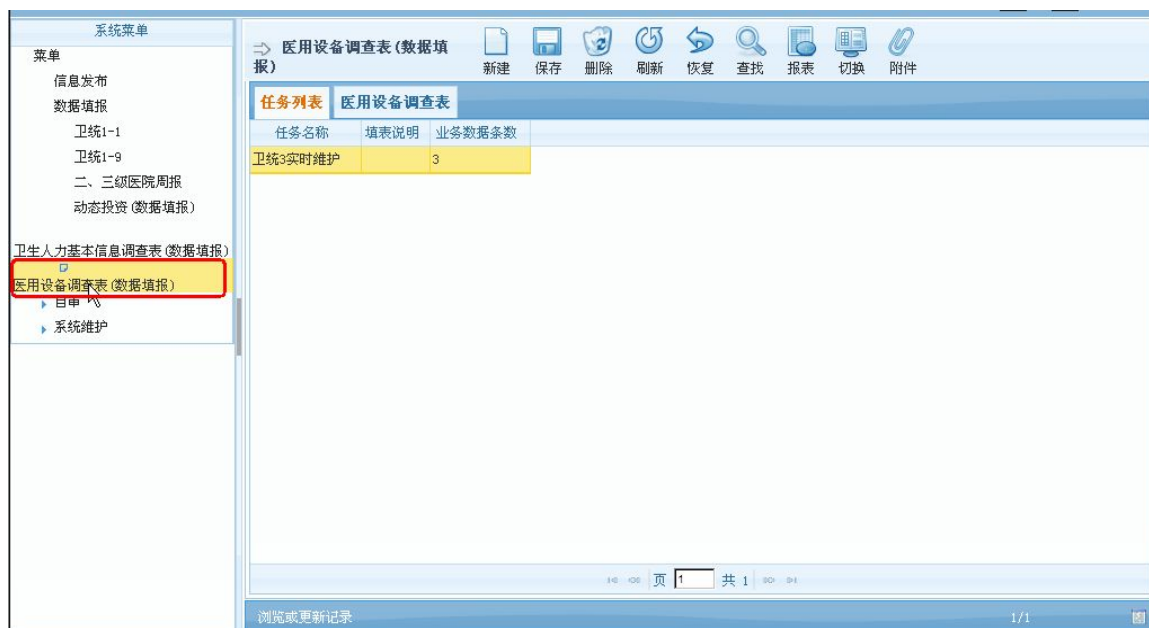


图 4-1 多行模式数据导出

2. 在页面上点击“医用设备调查表”，进入相应页面。如图 4-2 所示

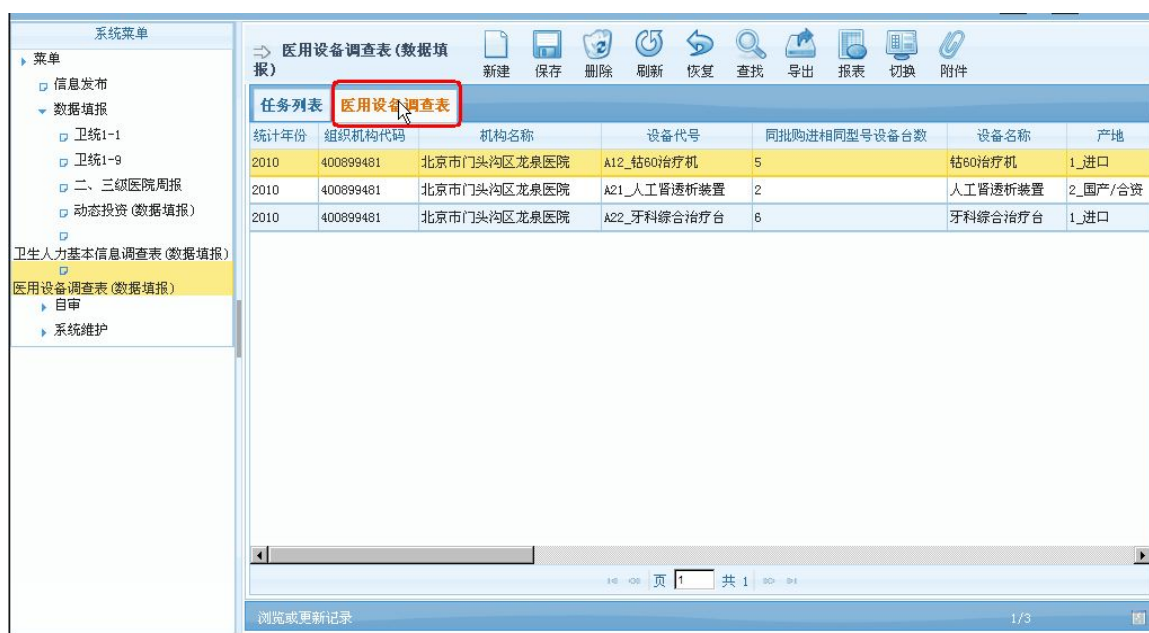


图 4-2 多行模式数据导出

3. 在医用设备调查表页面下点击“导出”按钮。如图 4-3 所示：

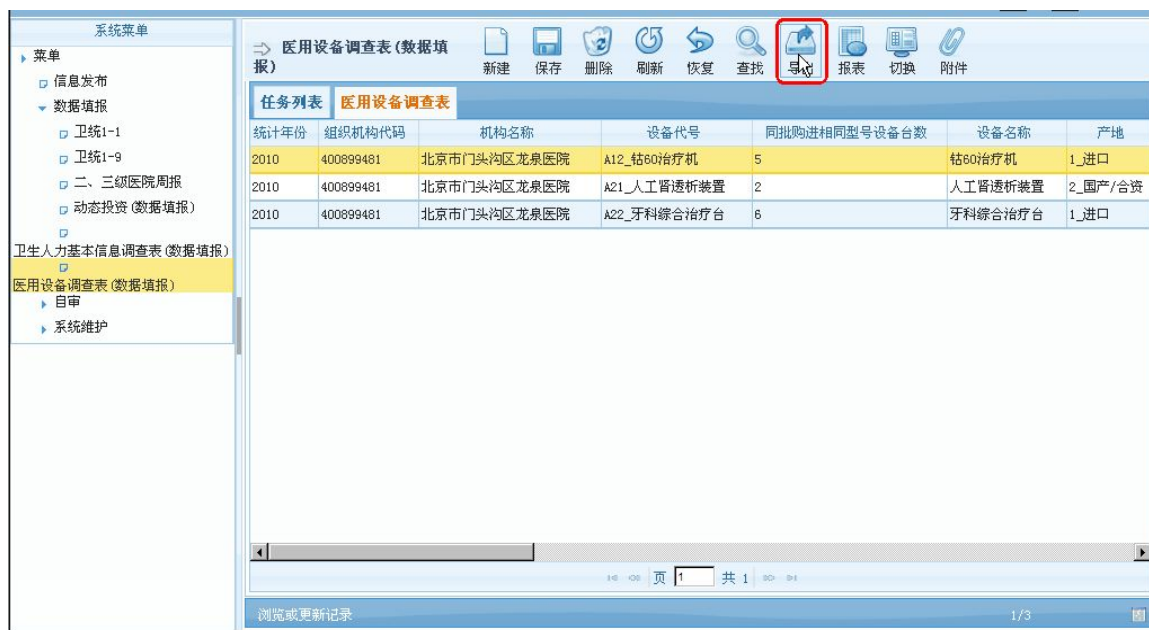


图 4-3 多行模式数据导出

4. 在系统出现导出提示框后，点击“保存”按钮。如图 4-4 所示：

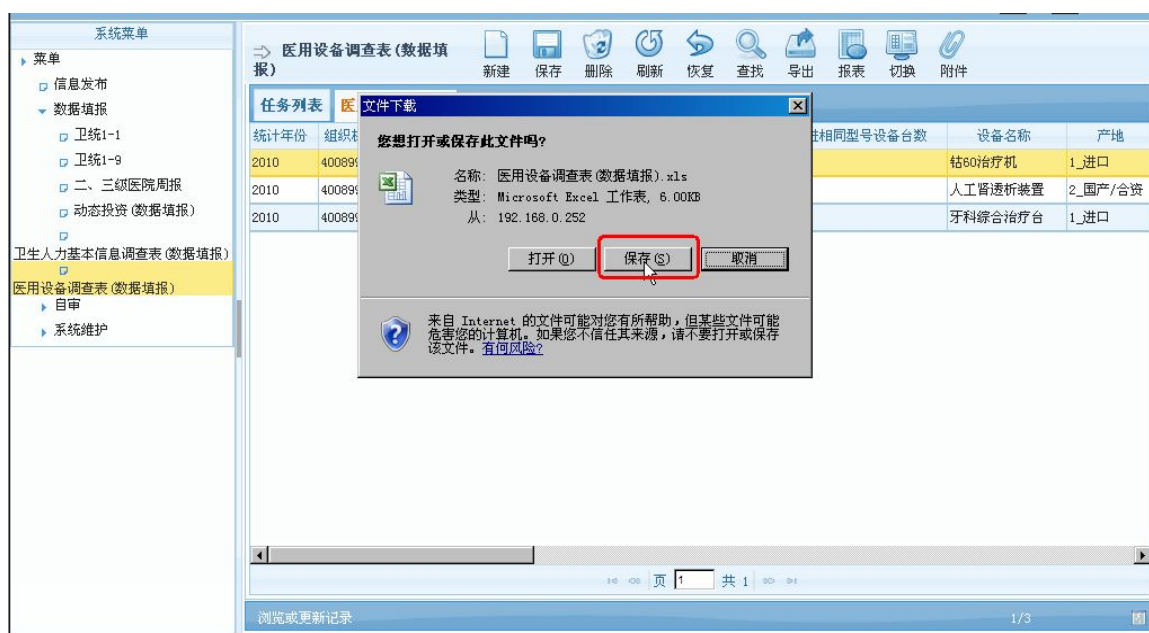


图 4-4 多行模式数据导出

5. 选择好本地目录后，点击“保存”按钮，文件可成功保存为 Excel 文件格式。如图 4-5 所示：



图 4-5 多行模式数据导出

6. 保存后可在本地打开查看 Excel 文件。如图 4-6 所示：

|    |      |           |             |             |           |         |      |
|----|------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------|
| 2  | 2010 | 400899481 | 北京市门头沟区龙泉医院 | A12_钴60治疗机  | 5_钴60治疗机  | 1_进口    | 4_荷兰 |
| 3  | 2010 | 400899481 | 北京市门头沟区龙泉医院 | A21_人工肾透析装置 | 2_人工肾透析装置 | 2_国产/合资 |      |
| 4  | 2010 | 400899481 | 北京市门头沟区龙泉医院 | A22_牙科综合治疗台 | 6_牙科综合治疗台 | 1_进口    | 2_美国 |
| 5  |      |           |             |             |           |         |      |
| 6  |      |           |             |             |           |         |      |
| 7  |      |           |             |             |           |         |      |
| 8  |      |           |             |             |           |         |      |
| 9  |      |           |             |             |           |         |      |
| 10 |      |           |             |             |           |         |      |
| 11 |      |           |             |             |           |         |      |
| 12 |      |           |             |             |           |         |      |
| 13 |      |           |             |             |           |         |      |
| 14 |      |           |             |             |           |         |      |
| 15 |      |           |             |             |           |         |      |
| 16 |      |           |             |             |           |         |      |
| 17 |      |           |             |             |           |         |      |
| 18 |      |           |             |             |           |         |      |
| 19 |      |           |             |             |           |         |      |
| 20 |      |           |             |             |           |         |      |
| 21 |      |           |             |             |           |         |      |
| 22 |      |           |             |             |           |         |      |
| 23 |      |           |             |             |           |         |      |
| 24 |      |           |             |             |           |         |      |
| 25 |      |           |             |             |           |         |      |
| 26 |      |           |             |             |           |         |      |
| 27 |      |           |             |             |           |         |      |
| 28 |      |           |             |             |           |         |      |
| 29 |      |           |             |             |           |         |      |
| 30 |      |           |             |             |           |         |      |
| 31 |      |           |             |             |           |         |      |
| 32 |      |           |             |             |           |         |      |

图 4-6 多行模式数据导出

## 4.2 数据在单行模式下导出

1. 在系统菜单中点击数据填报中的“医用设备调查表(数据填报)”，进入相应的页面。如图 4-7 所示：

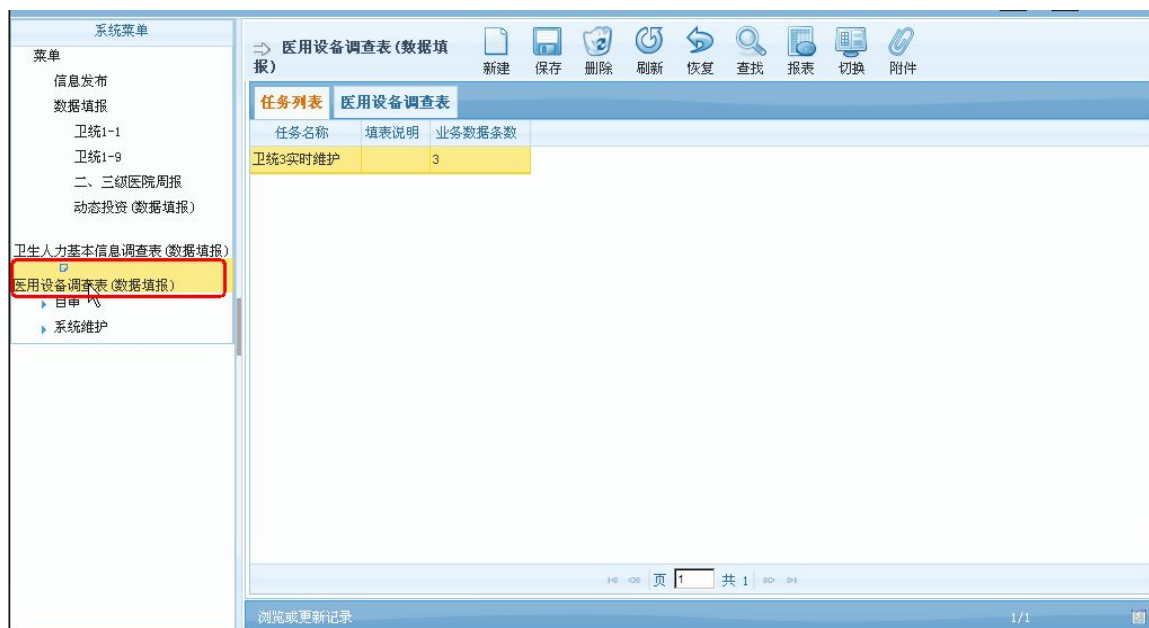


图 4-7 单行模式数据导出

2. 在页面上点击“医用设备调查表”，进入相应页面。如图 4-8 所示：

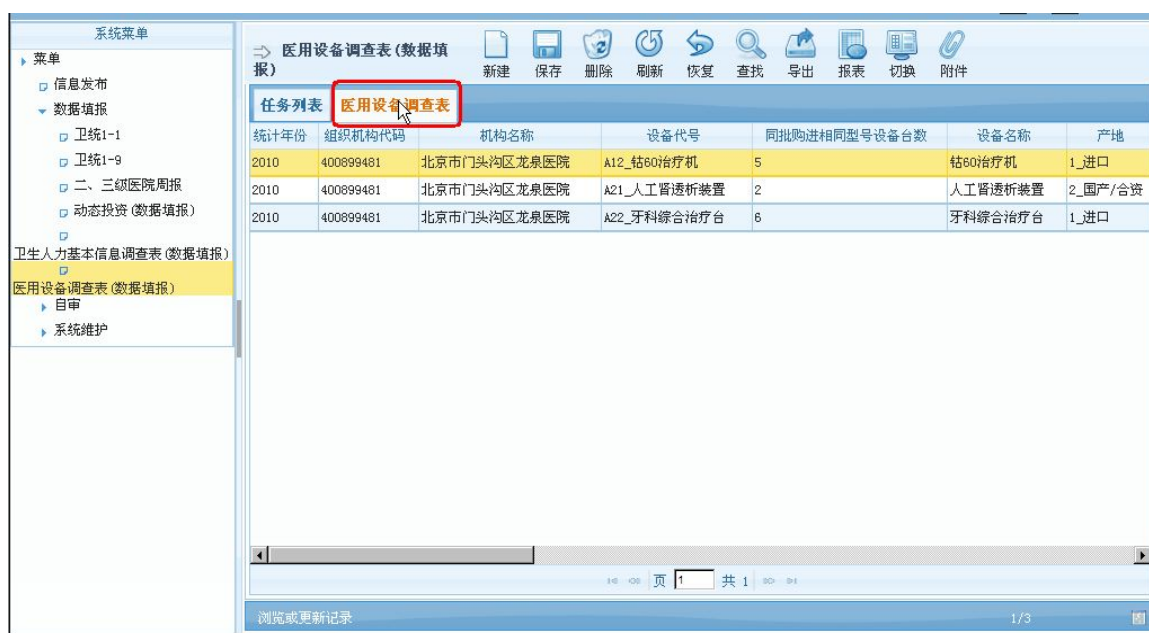


图 4-8 单行模式数据导出

3. 选择好要导出的数据，点击“切换”按钮。如图 4-9 所示：

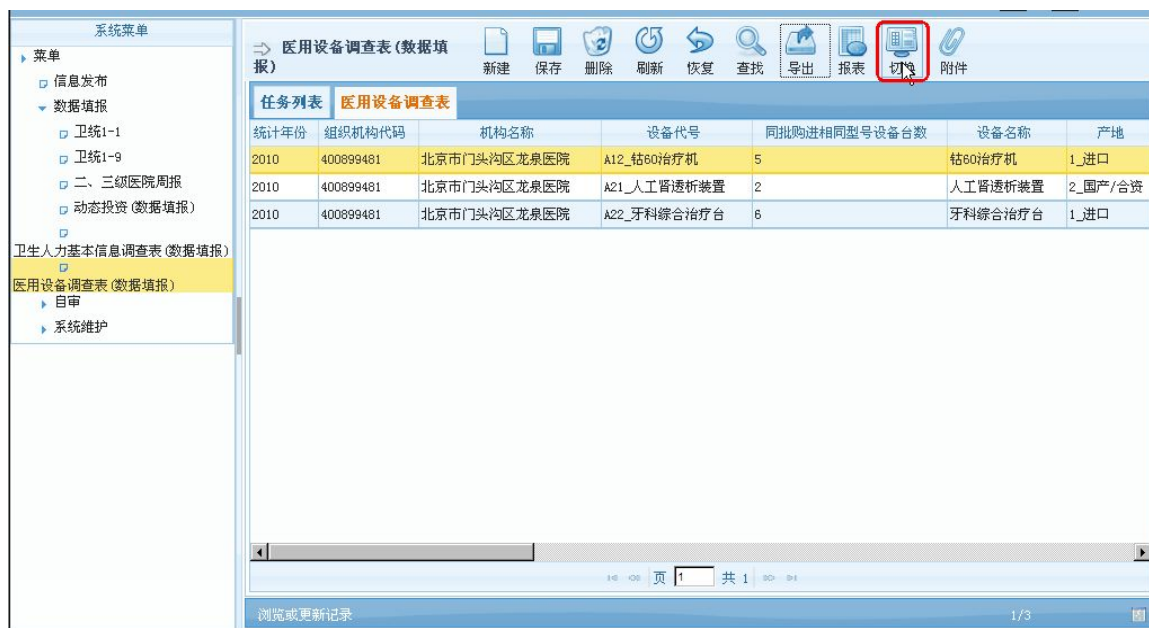


图 4-9 单行模式数据导出

4. 进入数据的详细信息页面。如图 4-10 所示：

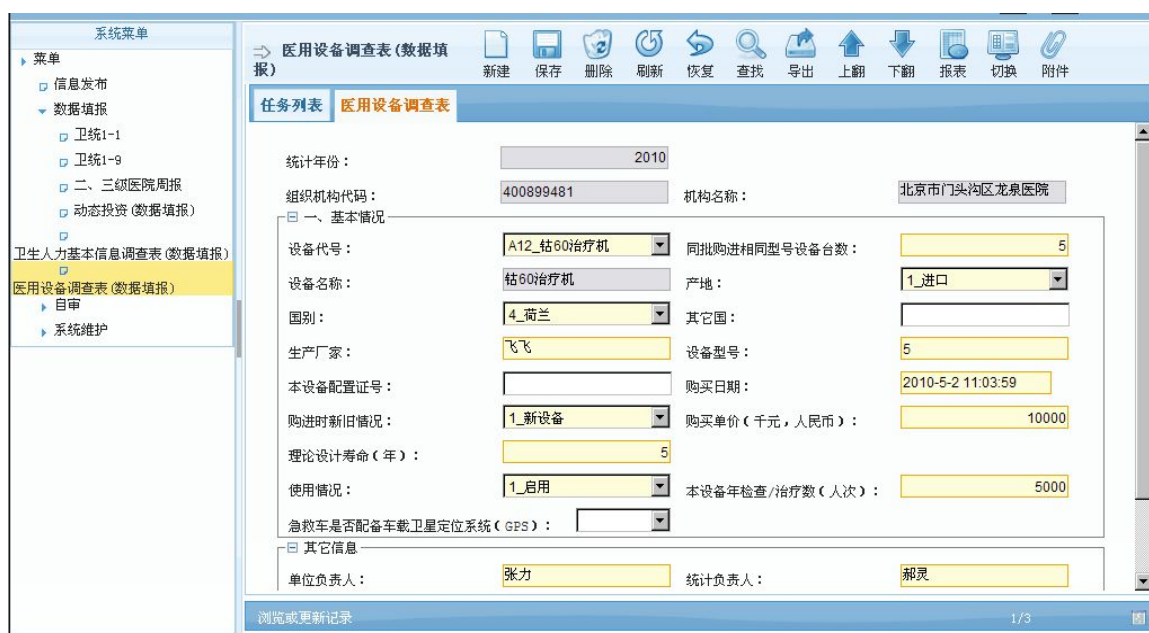


图 4-10 单行模式数据导出

5. 在此页面中点击“导出”按钮。如图 4-11 所示：

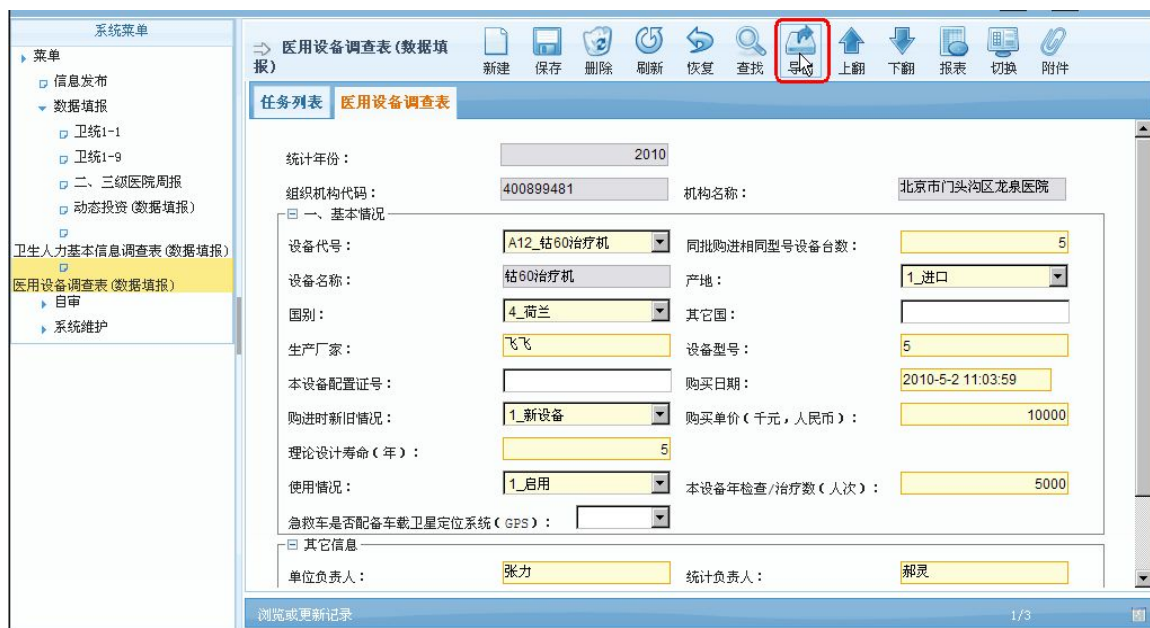


图 4-11 单行模式数据导出

6. 在系统出现导出提示框后, 点击“保存”按钮。如图 4-12 所示:

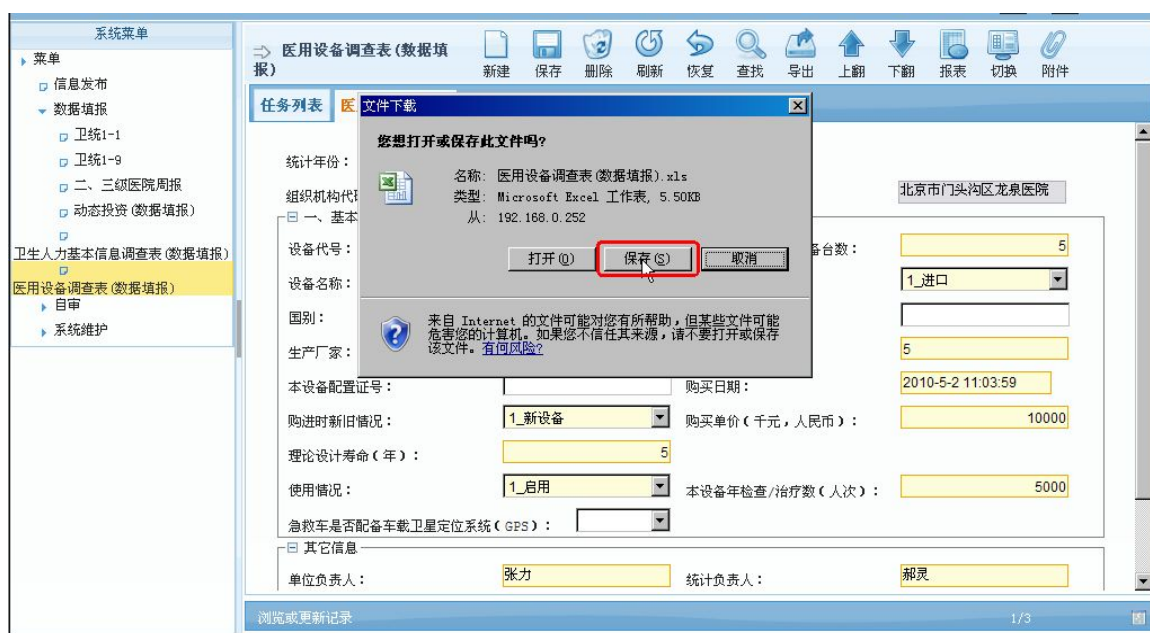


图 4-12 单行模式数据导出

7. 选择好本地目录后, 点击“保存”按钮, 文件可成功保存为 Excel 文件格式。如图 4-13 所示:



图 4-13 单行模式数据导出

8. 保存后可在本地打开查看 Excel 文件。如图 4-14 所示：

|    | A                     | B                 | C               | D                 | E | F | G |
|----|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|---|---|
| 1  | 医用设备调查表               |                   |                 |                   |   |   |   |
| 2  | 统计年份                  | 2010              |                 |                   |   |   |   |
| 3  | 组织机构代码                | 400899481         | 机构名称            | 北京市门头沟区龙泉医院       |   |   |   |
| 4  | 设备代号                  | A12_钴60治疗机        | 同批购进相同型号设备台数    | 5                 |   |   |   |
| 5  | 设备名称                  | 钴60治疗机            | 产地              | 1_进口              |   |   |   |
| 6  | 国别                    | 4_荷兰              | 其它国             |                   |   |   |   |
| 7  | 生产厂家                  | 飞飞                | 设备型号            | 5                 |   |   |   |
| 8  | 本设备配置证号               |                   | 购买日期            | 2010-5-2 11:03:59 |   |   |   |
| 9  | 购进时新旧情况               | 1_新设备             | 购买单价 (千元, 人民币)  | 10000             |   |   |   |
| 10 | 理论设计寿命 (年)            | 5                 |                 |                   |   |   |   |
| 11 | 使用情况                  | 1_启用              | 本设备年检查/治疗数 (人次) | 5000              |   |   |   |
| 12 | 急救车是否配备车载卫星定位系统 (GPS) |                   |                 |                   |   |   |   |
| 13 | 单位负责人                 | 张力                | 统计负责人           | 郝灵                |   |   |   |
| 14 | 填报人                   | 梅梅                | 联系电话            | 01083531111       |   |   |   |
| 15 | 报出日期                  | 2010-5-5 11:04:47 |                 |                   |   |   |   |
| 16 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 17 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 18 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 19 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 20 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 21 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 22 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 23 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 24 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |
| 25 |                       |                   |                 |                   |   |   |   |

图 4-14 单行模式数据导出

## 第五章. 其它注意事项

1. 医用设备调查表的填报过程为实时上报，数据填写完毕后执行保存操作即可，无需单独进行上报操作。
2. 保存后，如果系统提示当前的数据仅存在警告错误时，数据已保存且上报成功。用户可根据

根据实际情况，选择性的对数据进行修改。

3. 保存后，如果系统提示当前的数据存在强制错误时，用户必须按照提示内容对数据进行修改。